




До

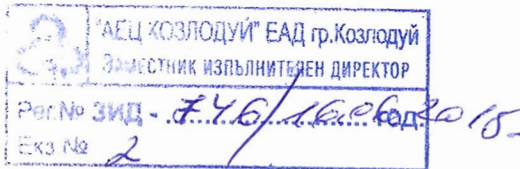

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на лабораторна апаратура”
рег. № в АОП 00353-2015-0145

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение вх. №Ф-3784/12.06.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

За обособена позиция №7 Кондуктометър лабораторен-преносим

В техническото описание на кондуктометъра е посочено, че трябва да е окомплектован с клетка с константа 0,1, а по-долу в спецификацията е посочено да бъде окомплектован с клетки за чиста и ултра чиста вода. В тази връзка имаме следните въпроси:

1. Какви клетки трябва да са включени в комплектацията?
2. Ако са повече от една и двете ли трябва да са проточни?
3. Посочено е измерване на чисти и ултрачисти води. Тъй като чистите води не надвишават 200 микросименса, измервателният обхват, който е посочен, а именно 0.00 до 19.99 микросименса и 0.00 до 500 микросименса за уреда ли се отнася или за клетките?

ВЪПРОС 2:

За Плик №1 Документи за подбор

Необходимо ли е за всяка обособена позиция участниците да представят отделен плик №1 Документи за подбор или е допустимо представянето на един Плик №1 Документи за подбор за всички обособени позиции, за които участникът участва.

ОТГОВОР 1:

1. Една клетка за мерене проточно на чисти и свръхчисти води.
3. Измервателният обхват се отнася до уреда.

ОТГОВОР 2:

Не е необходимо за всяка обособена позиция участниците да представят отделен плик №1 Документи за подбор. Съгласно точка 4.2. от Указанията за подготовка на офертите изискване за представяне на отделни пликове е поставено само за Плик №2 и Плик №3.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

