

# ДОГОВОР

№ 160000051

Днес, 22.07.2016 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Янчо Иванов Янков – Директор „Производство”, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 5359/28.07.2016г. на Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Лабимекс" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131007129, представявано от Димитър Буйнов Христов – Управител, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории", се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории по

- 1.1.1. Обособена позиция № 2 - Лабораторни съдове-други;
- 1.1.2. Обособена позиция № 3 - Лабораторни принадлежности;
- 1.1.3. Обособена позиция № 4 - Филтри и филтърна хартия,

наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагани цени – неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **22 382,85** лева, без ДДС /двадесет и две хиляди триста осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки/, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010, където:

2.1.1. Цената на доставката по Обособена позиция № 2 е в размер на 1 069,79 лева, без ДДС /хиляда шестдесет и девет лева и 79 стотинки/;

2.1.2. Цената на доставката по Обособена позиция № 3 е в размер на 14 303,41 лева, без ДДС /четиринацети хиляди триста и три лева и 41 стотинки/;

2.1.3. Цената на доставката по Обособена позиция № 4 е в размер на 7 009,65 лева, без ДДС /седем и девет лева и 65 стотинки/;

2.2. Цената по т.2.1, е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: УниКредит Булбанк;  
IBAN: BG65 UNCR 7000 1500 9737 96;  
BIC: UNCR BGSF;

### 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извърщена еднократно, в срок до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, считано от датата на двустранното му подписване.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

### 4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рисът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписането на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изиратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: [commercial@ppr.bg](mailto:commercial@ppr.bg), най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация /на български език/ на експедираната стока трябва да съдържа :

4.5.1. Приемно-предавателен протокол;

4.5.2. Декларация/Сертификат за произход;

4.5.3. Партиден сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти;

4.6. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, отговаряща на стандартните и техническите изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението ѝ по време на транспортиране.

4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.9 При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или неокомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактуира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, пеотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.13. За дата на доставка се счита датата на подписваие на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

## 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоката, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият према всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. Рекламации от установяването на отклоненията се оформя в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на коистатирани отклонения и/или несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които reklamацията се счита за уредена

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписане.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 6.3.1. Приложение №1 – Общи условия на договора;
- 6.3.2. Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- 6.3.3. Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- 6.3.4. Приложение №4 – Предлагани цени.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Гreta Михайлова – Химик „РМ-РХ”, Дирекция „Б и К”, тел.: 0973/72198 и Виолета Петрова – Р-л група „ФХК-ОЛ”, ЕП2, , тел.: 0973/73902.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Мария Ангелова – Мениджър продажби, тел.: 02/4224160.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Лабимекс” ООД  
1004 София  
Кв. Гоце Делчев, бл.261, офис Ч  
e-mail: [labimex@mail.bg](mailto:labimex@mail.bg)  
тел/факс: 02/4224160, 9621501  
ЕИК 131007129  
ИН по ЗДД 131007129

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
ДМИТИР ХРИСТОВ

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
e-mail: [commercial@ppr.bg](mailto:commercial@ppr.bg)  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР „ПРОИЗВОДСТВО”  
ЯНЧО ЯНКОВ

Директор “И и Ф”: ..... /Б. Димитров/

03.08.2016 г. /Б. Димитров/

Р-л У-ние “Търговско”: ..... /К. Каменова/

02.08.2016 г. /К. Каменова/

Р-л У-ние “Правно”: ..... /И. Иванов/

06.08.2016 г. /И. Иванов/

Химик РМ-РХ., Дир.”БиК”: ..... /Г. Михайлова/

01.08.2016 г. /Г. Михайлова/

Р-л група „ФХК-ОЛ”, ЕП2: ..... /В. Петрова/

01.08.2016 г. /В. Петрова/

Ст. юрисконсулт, У-е „П”: ..... /П. Илиева/

02.08.2016 г. /П. Илиева/

Н-к отдел “ОП”: ..... /С. Брешкова/

29.07.2016 г. /С. Брешкова/

### Изготвил:

28.08.2016 г. /И. Борисова/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	8
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	8
15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	8
16. НЕУСТОЙКИ .....	9
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	9
18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	9
19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	10
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	10
23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	11
24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	11

## **1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР**

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

## **2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изнълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на оределен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## **3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА**

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## **4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с носочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от склучване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

**4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

**4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

**4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безонасна работа на персонала на подизпълнителите си.

**4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

**4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**4.8. Комуникацията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**4.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на нлощадката и одити на подизпълнители, но реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

**5.1. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

**5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

## 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

**6.1. Данък удържан при източника**

**6.1.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**6.1.2. При възникване на данъчното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

**6.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

**6.2. Прилагане на СИДДО**

**6.2.1. Когато между Република България и страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване па

данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп па транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписане, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изиска разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо нисмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за

лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предназначени средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди нървоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да сазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлонреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите нравилници в АЕЦ и открие наряди за допускане до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за

специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за изнолзване на ядрената енергия.

**11.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в нравилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен нодбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

**11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискват и извършват проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

**11.10.** Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите меронриятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

**11.11.** Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безонасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

**11.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по даден от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

**11.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпорежданя на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

**11.14.** В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

**11.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

**11.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за онаване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гарантационния срок.

**11.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

**11.18.** При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

**11.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

**11.20.** Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително нодизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

**12.1.** При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лината, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

### **13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ**

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда и утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, стапала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол но изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не наруши оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площацки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се иравят копия на документите.

### **14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площацката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площацката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за иредотвратяване и отстраняване на екологични щети.

### **15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отнадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## **16. НЕУСТОЙКИ**

- 16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** занлаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.
- 16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.
- 16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## **17. ПРЕКРАТИВАНЕ И РАЗВАЛИНЕ НА ДОГОВОРА**

- 17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.
- 17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.
- 17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.
- 17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправлата страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.
- 17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и ирнети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.
- 17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска занлаща на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.
- 17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## **18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

- 18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след

сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## **19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ**

19.1. Всички спорни въпроси, произлизящи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## **20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ**

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефон или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

## 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

## 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Лабимекс“ ООД  
1004 София  
Кв. Гоце Делчев, бл.261, офис Ч  
e-mail: [labimex@mail.bg](mailto:labimex@mail.bg)  
тел/факс: 02/4224160, 9621501  
ЕИК 131007129  
ИН по ЗДД 131007129

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
ДИМИТЪР ХРИСТОВ




### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
e-mail: [commercial@ppr.bg](mailto:commercial@ppr.bg)  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДС BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР „ПРОИЗВОДСТВО“  
ЯНЧО ЯНКОВ

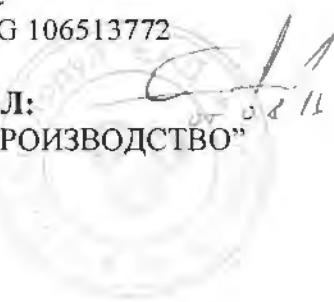

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА ДОСТАВКА НА  
ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ /СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА / И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

**1. Обособена позиция №1.** Лабораторни мерни съдове-стъклени.

№	ID BaaN	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ		Мерна единица	Количество
			Мерителен обем	Градуировка		
1.	109340	Цилиндър	Цилиндър мерителен, обем $50 \pm 0,5$ мл, Клас А,висока форма, синя градуировка през 1мл	брой	5	
2.	109341	Цилиндър	Цилиндър мерителен, обем $100 \pm 0,5$ мл, Клас А,висока форма, синя градуировка през 1мл	брой	5	
3.	109344	Цилиндър	Цилиндър мерителен, обем $500 \pm 2,5$ мл, Клас А,висока форма, синя градуировка през 5мл	брой	2	
4.	109358	Пипета Фол	Пипета Фол тип шприц, клас А, обем $10 \pm 0,02$ мл, с кафява градуировка.	брой	10	
5.	20128	Колба	Колба мерителна 2000мл	брой	2	
6.	20169	Колба	Мерителна, клас на точност А, $100 \text{ мл} \pm 0,1$ при $20^\circ\text{C}$ , сертифицирана по DIN, с пласти масова запушалка	брой	90	
7.	20171	Колба	Мерителна, клас на точност А, $1000 \text{ мл} \pm 0,40$ при $20^\circ\text{C}$ , сертифицирана по DIN, пласти масова запушалка	брой	3	
8.	20196	Колба	Колба мерителна 50мл; клас т.А; тъмно стъкло	брой	10	
9.	20197	Колба	Колба мерителна 100мл; тъмно стъкло	брой	10	
10.	20243	Пипета	Пипета градуирана, 0,5 мл през 0,01, клас на точност AS $\pm 0,005$ мл при $20^\circ\text{C}$ , сертифицирана по DIN	брой	20	

11.	20244	Пипета	Фол 1 мл, клас на точност AS $\pm 0,007$ мл при 20°C, сертифицирана по DIN	брой	15
12.	20583	Чаша	Бехер 1000мл, висока форма	брой	20
13.	20584	Чаша	Чаша Бехер 1000мл; ниска форма	брой	20
14.	20585	Чаша	Чаша Бехер 100мл; висока форма	брой	10
15.	20588	Чаша	Чаша Бехер 150мл; ниска форма	брой	10
16.	20589	Чаша	Чаша Бехер 250мл; висока форма	брой	10
17.	20590	Чаша	Бехер 250мл, ниска форма	брой	10
18.	20592	Чаша	Бехер 3000мл, ниска форма	брой	7
19.	20593	Чаша	Бехер 5000мл, ниска форма	брой	2
20.	20594	Чаша	Бехер 400мл, висока форма	брой	30
21.	20595	Чаша	Бехер 400мл, ниска форма	брой	60
22.	20597	Чаша	Бехер 50 мл, ниска форма	брой	10
23.	20598	Чаша	Бехер 600мл, висока форма	брой	20
24.	20599	Чаша	Бехер 600 мл, ниска форма	брой	30
25.	20600	Чаша	Бехер 800 мл, висока форма	брой	20
26.	20601	Чаша	Бехер 800 мл, ниска форма	брой	20
27.	45024	Колба	Мерителна, клас на точност A, 50 мл $\pm 0,06$ при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	брой	50
28.	45027	Колба	Мерителна, клас на точност A, 500 мл $\pm 0,25$ при 20°C, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	брой	30
29.	45062	Чаша	Чаша Бехер 2000мл, висока форма	брой	10
30.	45063	Чаша	Бехер 2000мл, ниска форма	брой	10
31.	65222	Колба	Колба мерителна, V=1000ml, тъмно стъкло, клас на точност A	брой	5

**2. Обособена позиция №2. Лабораторни съдове-други.**

№	ID BaN	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	Мерна единица	Количество
1.	109352	Фуния	Фуния за бързо филtrуване, с диаметър 70-80мм, оребрена отвътре.	брой	5
2.	109354	Банка	Банка стъклена, градуирана, с обем 5000мл, с пластмасова капачка на винт за отвор 45мм.	брой	2
3.	20205	Блюдо	Блюдо Петри, стъклено, ф120 мм	брой	10
4.	20213	Блюдо	Блюдо Петри, стъклено, ф150 мм	брой	10
5.	20373	Колба	Колба Ерленмайер 1000мл; с широко гърло; градуирана	брой	5
6.	20380	Колба	Колба Ерленмайер 500мл; с широко гърло; градуирана	брой	5
7.	20383	Колба	Колба йодно число 100мл; с пластмасова запушалка	брой	35
8.	20410	Кристализатор	Кристализатор с цилиндрична форма, ф95мм, V= 300мл, плоско дъно	брой	3
9.	20412	Кристализатор	Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140°C, цилиндрична форма, ф190мм, V= 2000мл, плоско дъно	брой	3
10.	20444	Блюдо	Блюдо Петри, стъклено, ф100 мм	брой	10
11.	20446	Блюдо	Блюдо Петри, стъклено, ф80 мм	брой	25
12.	20517	Стъкло	Стъкло увеличително (лупа) x 8	брой	2
13.	20518	Стъкло	Стъкло часовниково ф60 мм	брой	10
14.	20611	Колба	Колба смукателна, V=1000мл	брой	5
15.	45038	Кристализатор	Кристализатор цилиндрична форма;плоско дъно; ф230; 3500 мл	брой	3
16.	91310	Фуния	Фуния удължителна за колонка със смола; опаковка x 20 бр.; обем 25 ml	брой	1

**3. Обособена позиция № 3. Лабораторни принадлежности.**

№	ID BaaN	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ		Мерна единиц а	Количеств а
			брой	0		
1.	108746	Дозатор	Дозатор към шипета, устойчив на органични разтворители, с вариращ обем от 5 до 50 ml	брой	5	
2.	117263	Комплект за пробоотбиране	Комплект за пробоотбиране UniSampler "EX" с една дълбинителна стъклена бутилка, 1000 ml	брой	2	
3.	119906	Статив	Статив за центрофужна епруветка от 50ml., 20 отвора, материал АВС	брой	2	
4.	119907	Статив	Статив за центрофужна епруветка от 100ml., 20 отвора, материал АВС	брой	2	
5.	121228	Щипка	Щипка лабораторна за колби, стоманена с полиамилно покритие, дължина 230 mm, размер на отвора от 16 до 60 mm	брой	2	
6.	13919	Индикатор за pH	Индикатор за pH универсален (хартия индикаторна) pH = 0 - 14, на лентички ,100 бр лентички в пластмасова кутия със скала - цвят/pH	брой	33	
7.	19736	Дозатор	Дозатор към шипета за киселини и основи 0 - 5 ml	брой	5	
8.	19737	Дозатор	Към шипета, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с вариращ обем 1-10ml	брой	10	
9.	20097	Шпатула	Шпатула метална, от единния край - лъжица, от другия - лоска; обща дължина 180mm	брой	40	
10.	20152	Статив	Статив вертикален, за изсушаване на лабораторна стъклария, свободно стоящ	брой	1	
11.	20300	Щипка	Щипка магнитна за магнитчета, 250/8mm	брой	2	
12.	20988	Маркуч	Маркуч силиконов, лабораторен, ф10x14 mm	м	50	
13.	21059	Маркуч	Лабораторен, каучуков, ф8-12 mm (d-D)	м	50	
14.	45040	Шпатула	Шпатула двойна, пластмасова, 150/18/20mm	брой	5	

15.	45093	Накрайник	За автоматична пипета, тип Eppendorf, син цвят, 1мл	брой	2000
16.	47512	Копница	Копница за реактиви за бх 1л	брой	6
17.	71849	Пипета	За еднократна употреба(полистилен), 3мл, градуирана, нестерилна, опаковка 1брой съдържа 500 пипети	брой	10
18.	83255	Лента pH индикаторна	Лента pH индикаторна ; диапазон pH= от 0 до 2,5 ; 100 ленти в опаковка	брой	30
19.	90823	Лепенки;	Лепенки; за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95 x 95мм - комплект по 500 бр.	К-т	1
20.	90824	Лепенки;	Лепенки; за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150 x 150мм - комплект по 250 бр.	К-т	1
21.	91365	Пипета	Пипети тип гастроър за еднократна употреба /полиглилен/ , градуирани до 5 мл., нестерилини, 1 бр.= 1 пипета	брой	1200
22.	91366	Пипета	Пипета за еднократна употреба, тип PE-LD, 2ml	брой	200
23.	91367	Пипета	За еднократна употреба; тип PE-LD, 1мл	брой	300
24.	93187	Дозатор	Към шипета, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с вариращ обем 0,2-2мл	брой	10
25.	93188	Дозатор	Към шипета, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с вариращ обем 0,5-5мл	брой	12
26.	93189	Дозатор	Към шипета, устойчив на киселини и основи, комплект, с вариращ обем 1-10мл	брой	2
27.	95123	Маркуч	Силиконов, ф8x14мм, висока еластичност	м	30

**4. Обособена позиция №4. Филтри и филтърна хартия**

№	ID BaaN	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	Мерна единиц а	Количество 0
1.	105960	Филтър	Филтър черна лента, №388, Ø150мм, в опаковка 100 филтъра	брой	3
2.	106030	Филтър	Филтър, тип стъклени влакна с високо задържане, d=47mm, среден размер на порите 0,7мм за определяне на общи очиствания в дизелово гориво, 1бр. опаковка съдържа 100 бр. филтри	брой	1
3.	13949	Филтър	Филтър синя лента, №391, Ø150, в опаковка 100 филтъра	брой	20
4.	13969	Хартия филтърна	Хартия филтърна 50x50, пакетирана; 1 пакет= 12.5kg	kg	175
5.	13990	Филтър	Филтър синя лента; Ø90мм безепелен; 100 филтъра в 1 отаковка	брой	3
6.	13991	Филтър	Филтър бяла лента, целулозен, №389, Ø150mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	брой	8
7.	20131	Филтър	Филтър мембраниен , големина на порите Ø0.45µm, диаметър на филтъра 47mm, опаковка от 100бр.	брой	10
8.	22630	Филтър	Филтър натънаг Ø24cm; 1бр.опаковка=100бр. филтри	брой	7
9.	22672	Филтър	Филтър; бяла лента; тип Filtrac; Ø50mm	брой	5
10.	46280	Хартия филтърна	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 460 mm, от едната страна с полисиленово покритие, не проникващо течности	брой	1
11.	95115	Хартия	Хартия лабораторна почистваща, ролка с размери - 380x205 mm	брой	160


**5. Обособена позиция №5. Лабораторни съдове-пластмасови**

№	ID BaaN	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ		Мерна единиц а	Количеств о
			Брой	Брой		
1.	100294	Буркан	Буркан /контейнер/, PP, прозрачен, V=125ml, φ=52mm, H=74mm	брой	40	
2.	12677	Банка	Банка пластмасова с капачка, 1л	брой	250	
3.	12678	Банка	Банка пластмасова с капачка, 250мл	брой	150	
4.	20206	Вана	Вана пластмасова, 20л. прибл. размери 380*280*200mm	брой	15	
5.	20278	Тава	Тава PP, киселинноустойчива, с приблизителни размери: 353/252/21mm	брой	3	
6.	45097	Пръскалка	Пръскалка полипропиленова 250мл	брой	12	
7.	91372	Чаша	Чаша Бехер; тefлон PTFE;диам.90мм;вис.127мм;обем 600ml	брой	5	

**Задължителни изисквания:**

1. В предоставените от фирмите-участници оферти Ѹмъни първокласни лабораторни съдове, от дадена обособена група, да бъде посочен **каталожен номер**, названието на каталога и името на фирмата-производител.
2. Да се осигурият оригиналните каталози с подробна техническа информация.
3. За Обособена позиция №1. Лабораторни мерни съдове-стъклени – на самите съдове, които са с клас на точност А и AS да има обозначен партиден номер с цел проследяване на партидния сертификат на фирмата производител в нейния уебсайт.
4. При входящия контрол в АЕЦ “Козлодуй”-ЕАД, да се представи партиден сертификат за качество, съгласно изискванията във соответствието с EN ISO стандарти.

**Изготвили:**

1. Р-л ля ФХК ср ИХ :.....  


/Н. Манолова /  


Лабинекс ООД, гр. София 1404, ж.к. Гене Денчев бп 261, офис Ч.тел. 02/42241 60, 962 15 01, факс 02/962 15 01, ЕИК 131007129, НИ по ЗНДС №  
БГ131007129

ОБРАЗЕЦ по т.И 2.2. ком. Образец на обретение  
хъм. Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на обретени с предмет

"Лостаката на лаборатории склове (стъклария и пластмаса), производствени и консултативни за химични лаборатории"  
С ПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Обособена позиция №2 - ЛАБОРАТОРИИ СКЛОВЕ-ДРУГИ


№ на обособлената позиция	Наименование, технически показатели, описание и приложение на предмета на ВЪЗДУШЕНТА	Показатели на предмета на предлатата	Една, няколко	Срок на доставка/дата	Друга информация, коя Участникът смята за необходимо да предостави	
1	2	3	4	5	6	
1	Фуния за бирюл филтриране, с диаметър 70-80мм, пребърдана от метал	Фуния за бирюл филтриране, с диаметър 70-80мм, пребърдана от метал	брой	5	45 дни	VTR Glas, Чехия 63242105275
2	Банка стъклена, прахулярие, с обем 500мл, с пластмасов капачка на винти с отвор	Банка стъклена, прахулярие, с обем 500мл, с пластмасов капачка на винти с отвор	брой	2	45 дни	Kavalier, Чехия 2070M/5000
3	Банка Петри, стъклена, ф120мл	Банка Петри, стъклена, ф120мл	брой	10	45 дни	VTR Glas, Чехия 632492004120
4	Банка Ерленхайер 1000мл; с широкото горло;	Банка Ерленхайер 1000мл; с широкото горло;	брой	10	45 дни	VTR Glas, Чехия 632492005150
5	Банка Ерленхайер 500мл; с широкото горло;	Банка Ерленхайер 500мл; с широкото горло;	брой	5	45 дни	Kavalier, Чехия 25/100
6	Банка Ерленхайер 250мл; с широкото горло;	Банка Ерленхайер 250мл; с широкото горло;	брой	5	45 дни	Kavalier, Чехия 25/500
7	Банка юноно чисто 100мл; с пластмасова затваралка	Банка юноно чисто 100мл; с пластмасова затваралка	брой	35	45 дни	Glasco, Чехия 071.202.14+
8	Кристализатор с цилиндрична форма, ф0.5мл, ф0.5мл, 1/2 ф0.5мл, пластмасова	Кристализатор с цилиндрична форма, ф0.5мл, ф0.5мл, 1/2 ф0.5мл, пластмасова	брой	3	45 дни	Kavalier, Чехия 174/300
9	Кристализатор, благороден стъклозастъпчачко стъклото 140°C, цилиндрична форма, ф19мл,	Кристализатор, благороден стъклозастъпчачко стъклото 140°C, цилиндрична форма, ф19мл,	брой	3	45 дни	Kavalier, Чехия 174/2000
10	Банка Петри, стъклена, ф100мл	Банка Петри, стъклена, ф100мл	брой	10	45 дни	VTR Glas, Чехия 632492004100
11	Банка Петри, стъклена, ф80мл	Банка Петри, стъклена, ф80мл	брой	25	45 дни	VTR Glas, Чехия 632492003040
12	Стъклена чаша (тупка) х8	Стъклена чаша (тупка) х8	брой	2	45 дни	Auxil, Немия 370062220
13	Стъклена чаша (тупка) ф60мл	Стъклена чаша (тупка) ф60мл	брой	10	45 дни	VTR Glas, Чехия 63495243040
14	Капка сухотестна, 1=0.0001	Капка сухотестна, 1=0.0001	брой	5	45 дни	Glasco, Чехия 074.202.04
15	Кристализатор цилиндрична форма, плоско дъно, ф230, 150мл	Кристализатор цилиндрична форма, плоско дъно, ф230, 150мл	брой	3	45 дни	Kavalier, Чехия 174/3500
16	Фуния уплътнена за капачка със смола; стакленка х 20бр.; обем 25ml	Фуния уплътнена за капачка със смола; стакленка х 20бр.; обем 25ml	брой	1	45 дни	Eicho, Гали 4C-120

ПОДНАС ПЕЧАТ:

Димитър Христов (име и фамилия)

27.05.2016г. (дата)


управлятел (должност на управителя/представителя участника)  
Лабинекс ООД (наименование на участника)

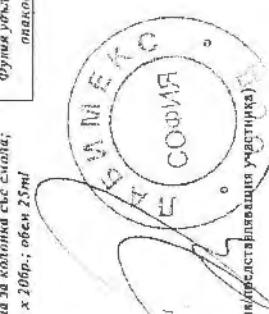

**① Funnel, plain, with short stem, angle 60°**

Trichter, Ebene, mit kurzem Stiel, Winkel 60°  
 Embudo, simple, canuto corto, angulo 60°  
 Entonnoir à 60°, tige courte  
 Воронка с коротким стеблем

Ordering No.	Cat. No.	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	l (mm)	Packing (pcs)
632 413 001 035	2350/35	35	6	35	10
632 413 001 045	2350/45	45	6	45	10
632 413 001 055	2350/55	55	6	55	10
632 413 001 075	2350/75	75	9	75	10
632 413 001 085	2350/85	85	9	85	10
632 413 001 100	2350/100	100	12	100	10
632 413 001 125	2350/125	125	16	125	6
632 413 001 150	2350/150	150	16	150	6
632 413 001 200	2350/200	200	24	150	6
632 413 001 250	2350/250	250	30	175	2
632 413 001 300	2350/300	300	34	175	2

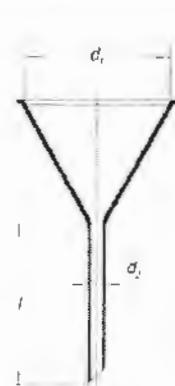

**② Funnel, analytical**

for quick filtration


Analysentrichter

Embudo para análisis

Entonnoir analytique à 60°

Воронка аналитическая

Ordering No.	Cat. No.	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	l (mm)	Packing (pcs)
632 421 052 055	2354/55	55	8	150	10
632 421 052 075	2354/75	75	8	150	10
632 421 052 100	2354/100	100	8	150	10

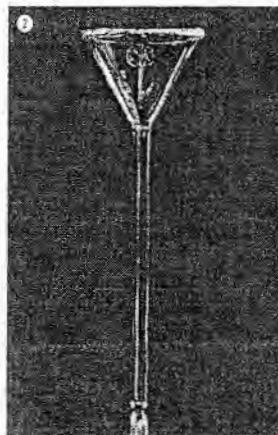

**③ Funnel, filling, for powder, with short wide stem**


Pulvertrichter, mit kurzem und weitem Stiel

Embudo, materiales sólidos, con canuto corto, ancho y nivelado

Entonnoir à poudre, à tige courte

Воронка лабораторная для порошков, короткий стебель

Ordering No.	Cat. No.	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	h (mm)	Packing (pcs)
632 413 103 050	2356/50	50	20	50	10
632 413 103 060	2356/60	60	20	60	10
632 413 103 080	2356/80	80	25	75	10
632 413 103 100	2356/100	100	25	95	10
632 413 103 120	2356/120	120	30	110	10
632 413 103 160	2356/160	160	35	135	6
632 413 103 200	2356/200	200	38	180	6



**④ Funnel for powder, with short oblique stem**


Pulvertrichter mit Kurzem Stiel, schräg

Embudo, materiales sólidos, con canuto corto y sesgado oblicuamente al final

Entonnoir à poudre, tige courte, bord biseauté

Воронка для порошков

Ordering No.	Cat. No.	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	l (mm)	Packing (pcs)
632 413 102 060	2357/60	60	10	30	1
632 413 102 080	2357/80	80	12	32	1
632 413 102 100	2357/100	100	15	35	1
632 413 102 150	2357/150	150	22	52	1

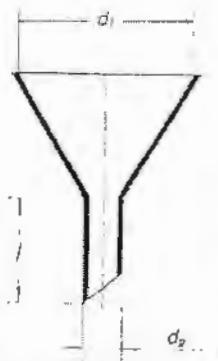


## REAGENT BOTTLES WITH SCREW GL 32 ACC. TO DIN- COMPLETE, MARKED SIMAX

Láhev reagenční s GL 32, PP – s modrým uzávěrem PP – vylévacím kroužkem SIMAX

Laborflaschen nach DIN, mit Kappe und Ring, SIMAX, GL 32

Flacons à réactifs à GL 32 à ISO-DIN, complet, marque SIMAX

Frascos borosilicatos con tapa a rosca GL 32, según ISO-DIN, impresión SIMAX

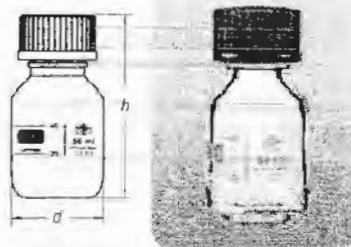

Cat. No. 2070 M	ISO 4796 - 1						
	Code	Capacity	GL	d	h	Packing	EAN
	1632	ml		mm	mm	Quantity	Carton
2070 M/50	1632414501050	50	32	46	91	10	8593419112140


## REAGENT BOTTLES WITH SCREW GL 32 ACC. TO DIN- COMPLETE, MARKED SIMAX BROWN

Láhev reagenční s GL 32, PP – s modrým uzávěrem PP – vylévacím kroužkem SIMAX - hnědá

Laborflaschen nach DIN, mit Kappe und Ring, SIMAX, GL 32, braun

Flacons à réactifs à GL 32 à ISO-DIN, brun, complet, marque SIMAX

Frascos borosilicatos con tapa a rosca GL 32 – topo

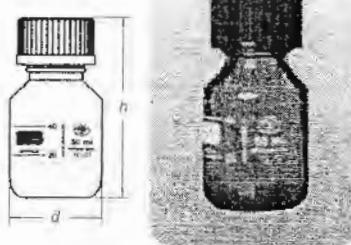

Cat. No. 2070 M	ISO 4796 - 1						
	Code	Capacity	GL	d	h	Packing	EAN
	1632	ml		mm	mm	Quantity	Carton
2070 M/50	1632414511050	50	32	46	91	10	8593419112188


## REAGENT BOTTLES WITH SCREW GL 45 ACC. TO DIN - COMPLETE, MARKED SIMAX

Láhev reagenční s GL 45, PP – s modrým uzávěrem PP – vylévacím kroužkem SIMAX

Laborflaschen nach DIN, mit Kappe und Ring, SIMAX, GL 45


Flacons à réactifs à GL 45 à ISO-DIN, complet, marque SIMAX

Frascos borosilicatos con tapa a rosca GL 45, según ISO-DIN, impresión SIMAX

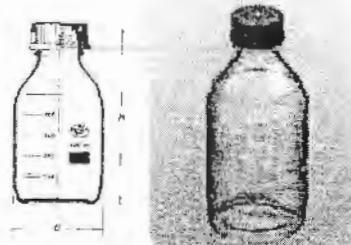

Cat. No. 2070 M	ISO 4796 - 1						
	Code	Capacity	GL	d	h	Packing	EAN
	600000632	ml		mm	mm	Quantity	Carton
2070 M/100	414321100	100	45	56	105	10	8593419604089
2070 M/250	414321250	250	45	70	143	10	8593419604096
2070 M/500	414321500	500	45	86	182	10	8593419604102
2070 M/1000	414321940	1000	45	101	203	10	8593419604119
2070 M/2000	414321950	2000	45	136	260	10	8593419604126
2070 M/5000	414321956	5000	45	181	330	6	8593419604133
2070 M/10000	414321966	10000	45	227	410	1	8593419604140
2070 M/20000	414321968	20000	45	288	505	1	8593419715563

Cap is heat resistant up to 140 °C / Tepelně odolná do 140 °C. / Die Kappe ist hitzbeständig bis 140 °C.  
La résistance à la température des capsules s'élève à 140 °C. / Tapa esterizable al vapor hasta 140 °C

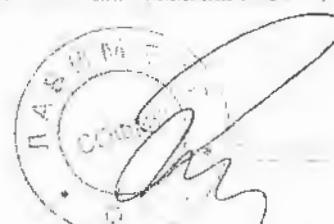

# DISHES PETRI/CULTURE FLASKS




## ① Dish, Petri, soda-lime glass

Petrishale  
Bandeja Petri  
Boite de Pétri  
Чашка Петри

111, 111  
210; 211

Ordering No.	Cat. No.	Wall thickness (mm)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs)
632 492 002 040	2290/40x12	1,2	40	12	288
632 492 002 050	2290/50x12	1,2	50	12	288
632 492 002 060	2290/60x12	1,2	60	12	144
632 492 003 060	2290/60x15	1,2	60	15	144
632 492 003 070	2290/70x15	1,35	70	15	72
632 492 003 080 *	2290/80x15	1,35	80	15	72
632 492 003 090	2290/90x15	1,35	90	15	72
632 492 001 100	2290/100x10	1,35	100	10	72
632 492 003 100	2290/100x15	1,5	100	15	72
632 492 004 100 *	2290/100x20	1,5	100	20	72
632 492 004 120 *	2290/120x20	1,5	120	20	72
632 492 005 150 *	2290/150x25	1,5	150	25	72
632 492 006 180	2290/180x30	1,9	180	30	10
632 492 006 200	2290/200x30	1,9	200	30	10
632 492 008 200	2290/200x50	1,9	200	50	10
632 491 001 071 *	2290/250x50	2,0	250	50	1
632 491 001 076 *	2290/300x55	2,0	300	55	1

autoclavable, SIMAX

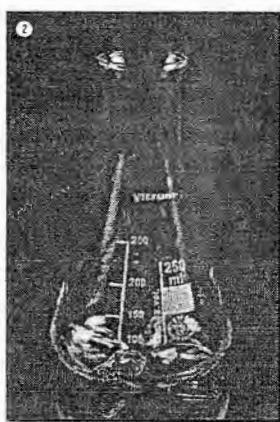


## ② Flask acc. to Erlenmeyer, wide neck, baffled, with rim

Schikanekolben nach Erlenmeyer, wide neck  
Matraz según erlenmeyer, para cultivos, cuello ancho  
Flacon Erlenmeyer, pour cultures microbiennes, col large  
Колба культуральная широкогорлая Эрленмейера

vtr: 35

Ordering No.	Volume (ml)	Flask dia. (mm)	Neck dia. (mm)	Height (mm)	Packing (pcs)
639 022 001 250	250	85	50	135	1
639 022 001 300	300	87	50	156	1
639 022 001 500	500	105	50	170	1
639 022 001 940	1000	131	50	215	1

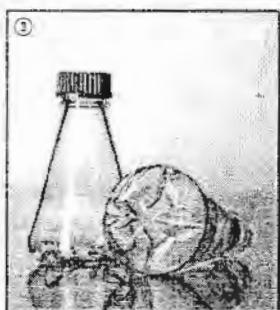


## ③ Flask acc. to Erlenmeyer, GL45, baffled, with screw cap

Schikanekolben nach Erlenmeyer, GL 45  
Matraz perturbador según Erlenmeyer, GL 45  
Flacon Erlenmeyer avec déflecteurs, GL45  
Колба Эрленмейера ребристая с винтовой крышкой

DURAN GROUP

Ordering No.	Cat. No.	Volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs)
637 212 833 655	21 283 35	250	81	145	4
637 212 834 454	21 283 44	500	105	180	4



## ④ Culture flask acc. to Erlenmeyer

Kulturflasche nach Erlenmeyer  
Matraz para cultivos, forma Erlenmeyer  
Flacon à cultures, forme Erlenmeyer  
Колба культуральная коническая

DURAN GROUP

Ordering No.	Cat. No.	Volume (ml)	Flask dia. (mm)	Height (mm)	Packing (pcs)
637 217 712 401	21 771 24	100	64	112	10
637 217 713 208	21 771 32	200	79	136	10
637 217 713 603	21 771 36	250	85	145	10
637 217 713 903	21 771 39	300	87	161	10
637 217 714 402	21 771 44	500	105	183	10
637 217 715 407	21 771 54	1000	131	232	1
637 217 716 309	21 771 63	2000	126	205	1




## FLASKS ERLENMEYER, NARROW NECK

Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá

Erlenmeyer – Kolben, enghalsig

Fioles d'Erlenmeyer, étroite ouverture

Matraces Erlenmeyer, graduados cuello estrecho

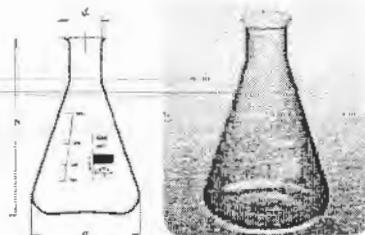

Cat. No. 24	ISO 1773						EAN Carton
	Code 600000632	Capacity ml	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	Packing Quantity	
24/25	411119025	25	42	22	75	10	8593419605871
24/50	417119050	50	51	22	90	10	8593419721069
24/100	417119100	100	64	22	105	10	8593419602993
24/200	417119200	200*	79	34	135	10	8593419724343
24/250	417119250	250	85	34	145	10	8593419603006
24/300	417119300	300*	87	34	160	10	8593419721083
24/500	417119500	500	105	34	180	10	8593419603013
24/1000	417119940	1000	131	42	220	10	8593419603020
24/2000	417119950	2000	166	50	280	6	8593419730306
24/3000	411119952	3000	187	50	310	6	8593419603044
24/5000	411119956	5000	220	50	365	2	8593419603051


## FLASKS ERLENMEYER, WIDE NECK

Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá

Erlenmeyer – Kolben, weithalsig

Fioles d'Erlenmeyer, large ouverture

Matraces Erlenmeyer, graduados, cuello ancho

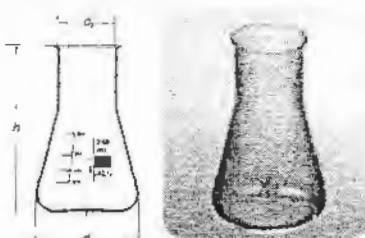


Cat. No. 25	ISO 24450						EAN Carton
	Code 600000632	Capacity ml	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	Packing Quantity	
25/25	411106025	25*	42	32	70	10	8593419605918
25/50	411106050	50	51	34	85	10	8593419605925
25/100	417106100	100*	64	34	105	10	8593419603068
25/200	417106200	200*	79	50	131	10	8593419724329
25/250	417106250	250	85	50	140	10	8593419724329
25/300	417106300	300*	87	50	156	10	8593419721045
25/500	417106500	500	105	50	175	10	8593419603082
25/1000	417106940	1000	131	50	220	10	8593419723087
25/2000	417106950	2000*	153	72	280	6	8593419730542

\* This size is out of norm ISO, DIN / Tato velikost je mimo normu ISO, DIN / Sondergrosse, nicht nach ISO, DIN  
Taille spéciale, non conforme aux normes ISO, DIN / Esta dimensión no corresponde a las normas ISO, DIN

A handwritten signature is written across the bottom right corner of the page.

## Flasks

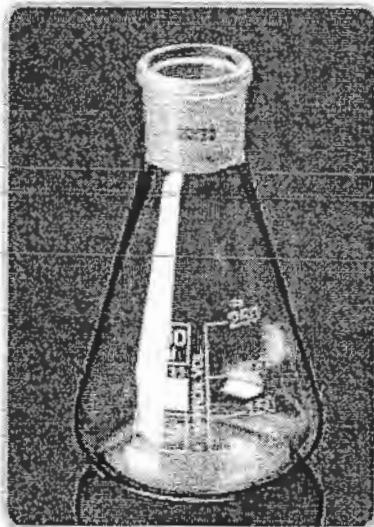

**Conical  
Flask with  
Joint**

These Flasks are as per ISO 4797 & USP Standards and is ideal for mixing liquids


Item Code	Nominal capacity ml	Socket Size	Approx. overall height mm.	Approx. overall diameter mm.	Pcs/ Pack
071.202.06 *	25	14 / 23	75	42	10
071.202.07 *	25	19 / 26	75	42	10
071.202.08 *	50	14 / 23	85	51	10
071.202.09	50	19 / 26	85	51	10
071.202.10 *	50	24 / 29	85	64	10
071.202.10A	50	29 / 32	85	64	10
071.202.11 *	100	14 / 23	105	64	10
071.202.12	100	19 / 26	105	64	10
071.202.13 *	100	24 / 29	105	64	10
071.202.14	100	29 / 32	105	64	10
071.202.17A*	200	29 / 32	131	79	10
071.202.18	250	19 / 26	140	85	10
071.202.19	250	24 / 29	140	85	10
071.202.20	250	29 / 32	140	85	10
071.202.21A*	300	29 / 32	156	87	10
071.202.22 *	500	19 / 26	175	105	10
071.202.22A*	500	24 / 29	175	105	10
071.202.23	500	29 / 32	175	105	10
071.202.25 *	1000	24 / 29	220	131	10
071.202.26	1000	29 / 32	220	131	10
071.202.27 *	1000	34 / 35	220	131	10
071.202.28	2000	29 / 32	280	166	6
071.202.29 *	2000	34 / 35	280	166	6
071.202.30 *	3000	45 / 40	310	187	1
071.202.31 *	5000	45 / 40	365	220	1

\* Non DIN

### Flask Erlenmeyer with Joint.


These Flasks comes with Ground Joint manufactured as per ASTM E 1404 type 2 Class 1 requirement.  
The Flasks are printed in white colour enamel.

Item Code	Capacity ml	Sub Division ml	Graduation Range	Joint Size	Pcs/ Pack
071.202.50	50	10	20 - 50	19 / 38	2
071.202.51	125	25	50 - 125	24 / 40	2
071.202.52	250	25	50 - 225	24 / 40	2
071.202.52A	300	25	100 - 300	24 / 40	2
071.202.53	500	50	100 - 500	24 / 40	2
071.202.54	1000	50	250 - 1000	24 / 40	1
071.202.55	2000	100	500 - 2000	24 / 40	1

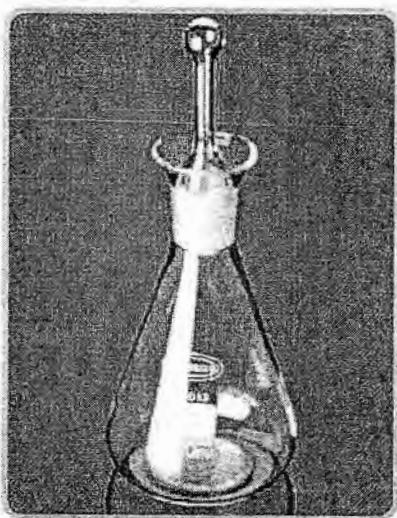

**Iodine  
Flask**

**ASTM**

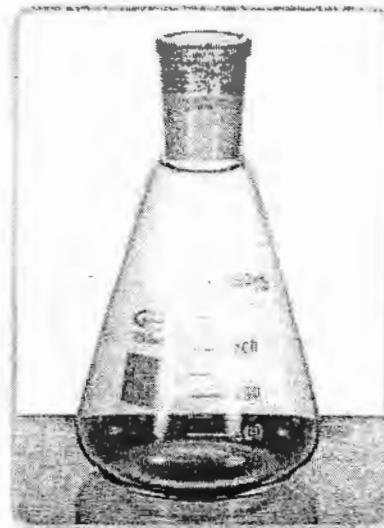

Determination of Iodine with ground joint and stopper

Item Code	Nominal capacity ml	Joint Size	Min. Cup Capacity ml	Pcs/ Pack
072.202.01	250	24 / 29	120	1
072.202.02	250	29 / 32	20	1 / 2
072.202.03	500	24 / 29	20	1 / 2
072.202.04	500	29 / 32	20	1 / 2



## Stoppers

# Stoppers

### Stoppers, Hollow with Flat bottom



- In compliance with DIN 12252 standard
- Used on different kind of jointed products like bottles, stoppered cylinder and jointed flasks mainly volumetric flasks
- Hexagonal head if placed on at head end avoids contamination of ground surface , with hexagonal form head it also helps in preventing the rolling of the stopper and provides a good grip.
- The stoppers below comes in drip tip form also which if placed on the flask helps liquid to return to the flask till the last drop

### Hollow Stoppers

#### DIN 12252

Item Code	N/S	Bottom Type	Pcs/ Pack
011.202.01	10 / 19	Flat	100
011.202.02	12 / 21	-	100
011.202.02A	14 / 23	-	100
011.202.03	19 / 26	-	100
011.202.04	24 / 29	-	100
011.202.05	29 / 32	-	100
011.202.06	34 / 35	-	100
011.205.01	10 / 19	Tip	100
011.205.02	12 / 21	-	100
011.205.03	14 / 23	-	100
011.205.04	19 / 26	-	100
011.205.05	24 / 29	-	100
011.205.06	29 / 32	-	100
011.205.07	34 / 35	-	100

PS : Hollow Stoppers can be provided in Amber color.  
Prices can be sent on request.

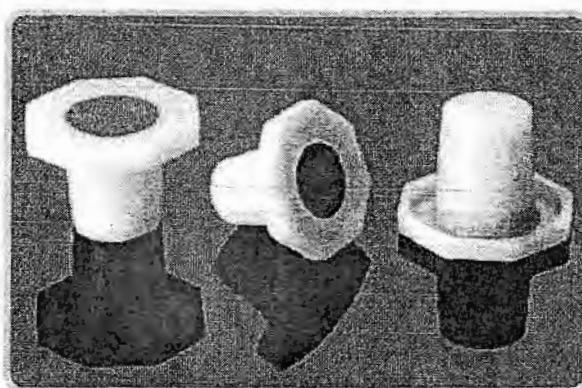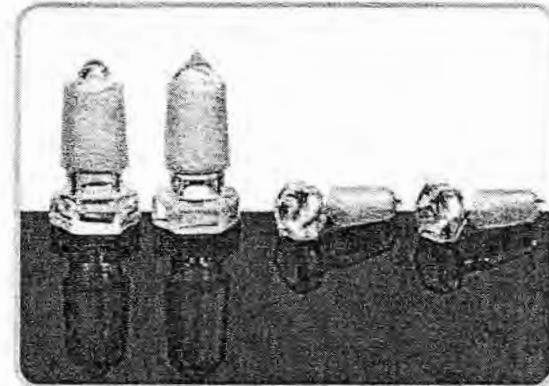

### Plastic Stoppers

#### Stopper, Polyethylene.

- Manufactured from polyethylene .
- In compliance with DIN 12254 standard
- Used mainly with volumetric flasks the hexagonal form large head provides good grip and also protects flasks from breaking if it drops accidentally.

#### White & Blue DIN 12254

Item Code	N/S	Pcs/ Pack
011.232.01	10 / 19	100
011.232.02	12 / 21	100
011.232.03	14 / 23	100
011.232.04	19 / 26	100
011.232.05	24 / 29	50
011.232.06	29 / 32	50
011.232.07*	34 / 35	50

\* Non DIN



2.8; 2.9; 2.49

## Crystallising dishes without spout



Miska krystalizační bez výlevky

Kristallisierschalen ohne Ausguß

Cristallisoirs sans bec

Cristalizadores sin pico



Cat. No. 174	DIN 12 337 PN 70 0121						EAN Carton
	Code 632	Capacity ml	d mm	h mm	Packing Quantity		
174/20	411624040	20	40	25	10	8593419602665	
174/40	411624050	40	50	30	10	8593419602689	
174/60	411624060	60	60	35	10	8593419602696	
174/100	411624070	100	70	40	10	8593419602702	
174/150	411624080	150	80	45	10	8593419643651	
174/300	411624095	300	95	55	10	8593419602726	
174/500	411624115	500	115	65	10	8593419602733	
174/900	411624140	900	140	75	10	8593419602740	
174/2000	411624190	2000	190	90	4	8593419602757	
174/3500	411624230	3500	230	100	4	8593419602764	

## Crystallising dishes with spout



Miska krystalizační s výlevkou

Kristallisierschalen mit Ausguß

Cristallisoirs avec bec

Cristalizadores con pico



Cat. No. 175	DIN 12 338 PN 70 0121						EAN Carton
	Code 1 632	Capacity ml	d mm	h mm	Packing Quantity		
175/20	411625040	20	40	25	10	8593419643675	
175/40	411625050	40	50	30	10	8593419602795	
175/60	411625060	60	60	35	10	8593419602801	
175/100	411625070	100	70	40	10	8593419602818	
175/150	411625080	150	80	45	10	8593419602825	
175/300	411625095	300	95	55	10	8593419602832	
175/500	411625115	500	115	65	10	8593419602849	
175/900	411625140	900	140	75	10	8593419602856	
175/2000	411625190	2000	190	90	4	8593419602863	
175/3500	411625230	3500	230	100	4	8593419602870	

*2.92*

AUXILAB S.L.

Material de laboratorio  
Laboratory supplies


CUENTAHILOS  
THREAD COUNTERS

Cuentahilos | Magnifying glasses

Fabricados en metal o plástico, presentan graduación milimétrica y en pulgadas en la superficie de apoyo y resultan de gran utilidad para observar la trama de un tejido, el detalle de un dibujo o fotografía u objetos semejantes.

Made in metal or plastic, the magnifying glasses present a base graduated in millimetres and inches and are very useful for observing fabric wefts, details of a drawing or photograph or similar objects.

Marca|Trademark: Zuzi

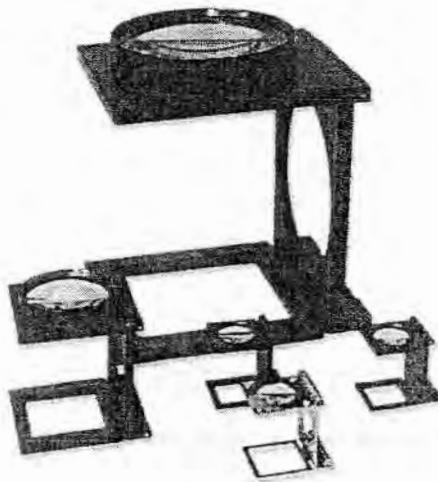

Referencia	Descripción	Diámetro	Aumentos
Code	Description	Diameter	Maginification
37000221	Plástico/Plastic	22 mm	10x
37000210	Metal/Metal	25 mm	8x
37000220	Plástico/Plastic	25 mm	8x
37000257	Plástico/Plastic	50 mm	5x
37000255	Plástico/Plastic	110 mm	3x

LUPAS  
MAGNIFYING GLASSES

Pol. Morea Norte, Calle D nº6 31191  
Berain (Navarra) ESPAÑA T: +34  
948 310 513 correo@auxilab.es  
[www.auxilab.com](http://www.auxilab.com)



*a*

# BOTTLES WEIGHING/GLASS WATCHES/STIRRING RODS



## ① Bottle weighing

with ground-in stopper and round knob

Wägeglas mit aufgeschliffenem Deckel

Frasco, pesafiltros

Pèse-filtre

Стаканчик для взвешивания (бюкс)



Ordering No.	Cat. No.	Version	d (mm)	h (mm)	Volume (ml)	Packing (pcs)
636 026 422 801	264.228.01	low	25	30	10	10
636 026 422 803	264.228.03	low	35	30	15	10
636 026 422 804	264.228.04	low	40	30	20	10
636 026 422 806	264.228.06	low	50	30	30	10
636 026 422 808	264.228.08	low	60	30	40	10
636 026 422 809	264.228.09	low	80	30	80	10
636 026 422 810	264.228.10	tall	25	40	10	10
636 026 422 811	264.228.11	tall	30	50	20	10
636 026 422 812	264.228.12	tall	35	60	35	10
636 026 422 813	264.228.13	tall	40	80	70	10



## ② Bottle weighing with SJ, low form


with stopper, without knob

Wägeglas mit eingeschliffenem Deckel mit Knopf

Frasco para pesar con SJ, tapa hermética sin empuñadura

Pèse-filtre avec couvercle coiffant rodé, à CS, forme basse

Стаканчик для взвешивания низкий (бюкс)

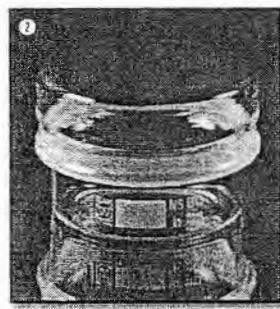

## ③ Glass watch



with flamed rim

Uhrglasschale

Vidrio de reloj

Verre de montre

Стекло часовое



Ordering No.	Cat. No.	d (mm)	Wall thickness (mm)	Packing (pcs)
634 952 430 760	170/40	40	1,8	10
634 952 430 790	170/50	50	1,8	10
634 952 430 840	170/60	60	1,8	10
634 952 430 860	170/70	70	1,8	10
634 952 430 910	170/80	80	1,8	10
634 952 430 950	170/90	90	1,8	10
634 952 430 010	170/100	100	1,8	10
634 952 430 060	170/110	110	1,8	10
634 952 430 070	170/120	120	1,8	10
634 952 430 080	170/125	125	1,8	10
634 952 430 110	170/140	140	1,8	10
634 952 430 120	170/150	150	1,8	10
634 952 420 200	170/200	200	1,8	10



## ④ Stirring rod, flamed


Rührstab, Enden verschmolzen

Barra de vidrio, mezcladora, puntas fundidas

L'agitateur en verre

Палочка для смещивания

vtr

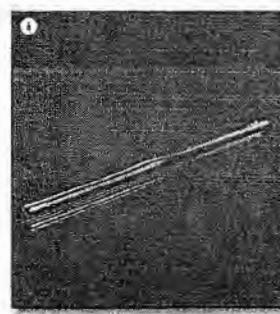

Ordering No.	Cat. No.	Diameter x length (mm)	Packing (pcs)
632 522 203 506	7765/4x200	4 x 200	10
632 522 204 502	7765/5x200	5 x 200	10
632 522 201 500	7765/5x250	5 x 250	10
632 522 204 503	7765/5x300	5 x 300	10
632 522 205 502	7765/6x200	6 x 200	10
632 522 205 503	7765/6x300	6 x 300	10
632 522 206 502	7765/7x200	7 x 200	10





## Flasks

As per ASTM E 133 standard Intended to use in ASTMD 86, D 233, D 801 & D 802

Item Code	Nominal capacity ml	Dia mm	Height mm	Side Dia mm	Arm Length	Pk/Size
073.205.01	125	68	215	7	7	2

### Distillation Flasks with 19/26 Joint

073.206.01	125	68	215	7	7	2
------------	-----	----	-----	---	---	---

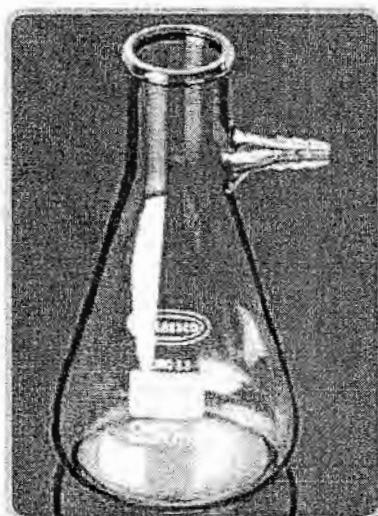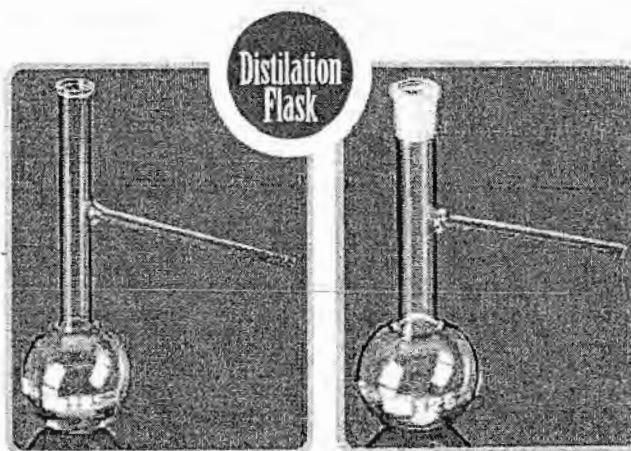

### Flask Filter with Glass Connector.

These Flasks are made from heavy wall which can withstand high vacuum. The flasks are printed the white colour enamel and is made as per ISO 6556 & USP Standards

Item Code	Nominal capacity ml	Pcs/ Pack
074.202.01	100	2
074.202.02	250	2
074.202.03	500	2
074.202.04	1000	2
074.202.05	2000	1

### Flask Filter with Glass Connector.

These Flasks are made from heavy wall which can withstand high vacuum. The flasks are printed the white colour enamel and is made as per ASTM E-1406, type 2 specifications.

Item Code	Capacity ml	Sub Division ml	Graduation Range	Pcs/ Pack
074.402.01	25	5	10 - 25	6
074.402.02	50	10	20 - 50	6
074.402.03	125	25	50 - 125	6
074.402.04	250	25	50 - 225	6
074.402.04A	300	25	100 - 300	6
074.402.05	500	50	100 - 500	6
074.402.06	1000	50	250 - 1000	6
074.402.07	2000	100	600-2000	1
074.402.09	4000	250	1000-4000	1



2.16

A BRAND OF  
EICHROM TECHNOLOGIES[Follow](#) | 189 Quick Links[Log In](#)


RADIOCHEMISTRY PRODUCTS

ION EXCHANGE RESINS

NUCLEAR MEDICINE

[Eichrom Technologies](#) > [Eichrom](#) > [Products](#) > [Info](#) > [Accessories](#)

## Accessories

[Accessories for Cartridges](#)  
[Accessories for 2mL Columns](#)  
[Accessories for 20mL Columns](#)[Part numbers and descriptions](#)[Products >](#)  
[Newsletters >](#)  
[Presentations >](#)[Technical Data](#)  
[View Application Notes >](#)  
[View Methods >](#)  
[Search Bibliography >](#)[Resources](#)  
[SDS >](#)  
[Certificates of Analysis >](#)  
[ISO 9000 >](#)  
[About Us >](#)  
[Contact Us >](#)  
[Links >](#)**Eichrom  
Technologies, LLC**  
Tel: (630) 963-0320  
Fax: (630) 963-1928  
Email: [info@eichrom.com](mailto:info@eichrom.com) >

### Cartridge Vacuum Box:

This 24 hole vacuum box has a high density polyethylene (HDPE) top for acid compatibility and a clear plastic bottom for visibility of collection tubes. Overall dimensions are 57 cm (long) x 14.5 cm (deep) x 18 cm (high.) The box comes complete with a screw in vacuum gauge, a rack insert which holds twenty-four 50cc centrifuge tubes, a starter package of yellow outer and white inner tips along with manifold plugs for sealing off unused holes.


The HDPE top can be removed and set on the bench top, supported by 2.5 cm legs, without disturbing cartridges and tips in use.

[Part number: AR-24-BOX](#)

A smaller, 12 hole version of this vacuum box is also available. Overall dimensions are 32 cm (long) x 14.5 cm (deep) x 18 cm (high.)

[Part number: AR-12-BOX](#)

Set up and use of these vacuum boxes is described in [Eichrom method VBS01](#).



### Inner Liner


Used in place of the rack insert, this clear plastic, one-piece liner is used to collect waste solutions. The total capacity is approximately 4 liters or up to 160 mL per sample if all 24 places are in use.

[Part number: AR-24-LINER](#)

A liner is available for use with the 12 hole vacuum box.

[Part number: AR-12-LINER](#)




**Column Tip Closures:**

These flexible, plastic sleeves fit on the bottom of an opened column to prevent complete drying out of the bed when the column needs to be used a second time in a procedure (e.g., [SRW01, SI-89/90 in Water](#)) They are available in packages of 100.

[Part number AC-130](#)

## Accessories for 20mL Columns

**20 mL Empty Columns and 200 mL Extension Funnel**

These columns, nominally 20 mL, have an inner diameter of 1.5 cm and a "packable" volume of 17 mL. Use them when a large bed volume of one of Eichrom's extraction chromatography or ion exchange resins is required. Columns are supplied with bottom frit pre-inserted, in packages of 20, including 20 bottom tip closures, caps and top frits.

[Part number AC-20E-20M](#)

These extension funnels are a single piece plastic reservoirs that snap securely into the top of Eichrom's 20 mL columns. They have a useful capacity of 200-250 mL. Available in packages of 20.

[Part number AC-20X-20M](#)

**Technical Info**

- [View Application Notes >](#)
- [View Methods >](#)
- [Search Bibliography >](#)

**Order Online**


Free ground shipping now available for all orders placed online within the continental US. >

**Resources**

- [SDS >](#)
- [Certificates of Analysis >](#)
- [ISO 9000 >](#)

- [About Eichrom >](#)
- [Contact Eichrom >](#)
- [Links >](#)

[CONTACT US](#) | ©2016 Eichrom Technologies, LLC • A GCI Company

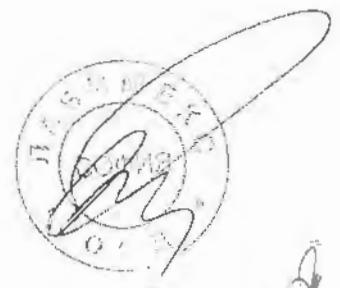

ПЪЛНО НАМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА, ТЕРДОСИИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН И ФАКС, ЕИК № И МН по ЗДС №

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

"Доставка на лаборатории съдове (стъклария и пластиса), принадлежности и консумативи за химични лабора горни"

Обособена позиция №3 - Лаборатории принадлежности

№ на обособената позиция	Наменование, технически показатели, опаковка и приложение, свидетелство ТС на Възложителя	Един. Марка	Кол-во	Срок на доставка/дни	Друга информация, ако участникът съекта за необходиим да представи
1	2	3	4	5	6
1	Дозатор към шинеста, устройство на органични разтворители, с единичен обем от 5 до 50ml	брой	5	45 дни	Dragon Lab, САЩ
2	Комплект за пробоподгответие UniSampler "EX" с една допълнителна стъклена буталка, с единична пръскаща енергия от 50ml, 20 отвора, материал ABS	брой	2	45 дни	Burk, Германия + Kavalier, Чехия
3	Стапитс за центрифугида енергия от 100ml.	брой	2	45 дни	Neolab, Германия
4	Стапитс за центрифугида енергия от 100ml. с D=30 mm, 20 отвори, материал ABS	брой	2	45 дни	Neolab, Германия
5	Цилиндрична лаборатория за колби, стоманена с с полизамидов покритие, дължина 230mm, размер 5ml	брой	2	45 дни	Bochle, Германия
6	Индикатор за pH универсален (картия индикаторна) pH=0-14, на лентички, 10бр.	брой	33	45 дни	Fioroni Filtris, Франция
7	Дозатор към шинеста за касетни и основи 0,5-5ml	брой	5	45 дни	Dragon Lab, САЩ
8	Дозатор към шинеста, устройство на касетни и основи, аналогично 3,7% солна и 0,5% азотна, с основи, аналогично 3,7% солна и 0,5% азотна, с Шинеста метална, от единия край-львица, от дръжка-плоска; общ дължина 160mm	брой	10	45 дни	Dragon Lab, САЩ
9	Стапитс термокален, за изсушенване на лаборатория стъклария, свободно състоящ същата магнитна за магнитчеста, 250/8mm	брой	2	45 дни	Bochle, Германия
10	Маргун силиконов, лабораторен, ф10x14mm	брой	1	45 дни	Astoria, Испания
11	Парфюмерен, кутийка, ф8-12 mm (d-D)	брой	2	45 дни	Brand, Германия
12	Парфюмерен, кутийка, ф10x14mm	брой	50	45 дни	VWR International, Австралия
13	Парфюмерен, кутийка, ф8-12 mm (d-D)	брой	5	45 дни	Kartell, Италия
14	Шинеста двойна, пластикова, 150/18/20ml	брой	10	45 дни	Deltina, Испания
15	Накрайник за автоматична пипета, тип Eppendorf, син цвет, 1ml	брой	2000	45 дни	VWR International, Австралия
16	Кошница за реактиви за бх.п.	брой	6	45 дни	Kartell, Италия
17	Пипета за еднократна употреба (полиетилен), 3ml, градуирана, нестерилизирана, опаковка 1брой	брой	10	45 дни	VWR International, Австралия
18	Ленти pH индикаторни, диапазон pH= от 0 до 2,5, 100 ленти в опаковка	брой	30	45 дни	Merc, Германия

19	<i>Летенки;</i> за изграждане на кутия, след пребоядисване с размери 95x95 mm. - комплект	К-рн	1	45 дни	Burkli, Германия	530.1-0012	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
20	<i>Летенки;</i> за изграждане на кутия, след пребоядисване с размери 150x150 mm.	К-рн	1	45 дни	Burkli, Германия	530.1-0012	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
21	<i>Планета</i> тип пастърър за ендокардиална употреба /изпичтаван/-градушкани до 50м, нестерилизирани	брой	1200	45 дни	Duchal, Испания	200000	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
22	<i>Планета</i> за ендокардиална употреба, тип PE-LD, 2mm	брой	200	45 дни	W.W International, Австралия	611.1-744	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
23	<i>Планета</i> Зърна ендокардиална употреба, тип PE-LD, 1mm	брой	300	45 дни	Karetell, Финландия	K3336	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
24	Към инцизивата, устройство за киселит и склероз, включително 37% солна и 65% лимонна, с основен включителител 37% солна и 65% лимонна.	брой	10	45 дни	Brand, Германия	4500120	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
25	Дозатор към инцизивата, устройство за киселит и склероз, включителител 37% солна и 65% лимонна, с основен включителител 37% солна и 65% лимонна.	брой	12	45 дни	Dragon Lab, Германия	21110001777	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
26	Дозатор към инцизивата, устройство за киселит и склероз, включител, устройство за киселит и склероз, компактен, с вградени обекти 1-10мл	брой	2	45 дни	Dragon Lab, Германия	21110002777	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ
27	Маргун силиконов, флексионен, висока еластичност	брой	30	45 дни	Belitach, Испания	300814	Изграждане от експертите на КАРДИО-СЕЙФ

MONTE CARLO

[e] MUNICIPAL BUDGETS IN TURKEY

卷之三

LA MUSICA EN LOS LIBROS DE ALEJANDRO HIRSCH

Логістичні засоби управління

3.1; 3.7; 3.8; 3.25; 3.16


## Bottle-Top Dispensers DispensMate

ansMate

same adjustment  
for use with

Smooth piston design provides  
effortless dispensing

losses appr  
agent conta  
tach and re  
iking glove

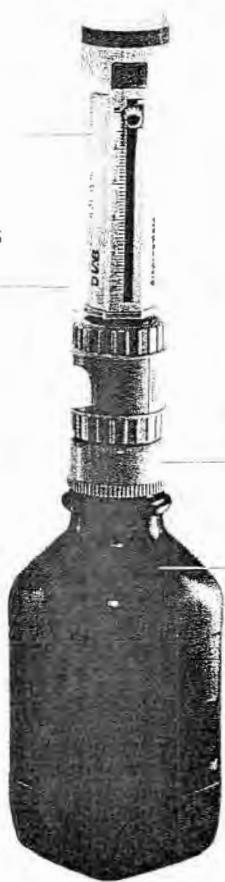

Adapters allow fitting to  
standard reagent bottles

Filling tube adjusts easily for  
different size bottles



ires

lient chem cal resistance, components are made of

PP at 121°C

autoclavable bottle-top dispenser covering a volume

r ranges of mL to 50mL

ge from 0.5 mL and maintenance

for cleaning and maintenance

flexible discharge tube with safety handle

mits fast and precise dispensing

Max. 500mbar, viscosity max. 500mm<sup>2</sup>/s,

or pressure 40°C, density max. 2.2g/cm<sup>3</sup>


perature in ax. is supplied with S40, GL32, GL38, GL25,

dispensemate plus is supplied with S40, GL32, GL38, GL25,

28 sized adapters

cification


Cat. No.	Volume Range mL	Graduation mL	A≤±		CV≤		Description
			%	µL	%	µL	
11100017777	0.5-5	0.1	0.5	25	0.1	5	
11100027777	1.0-10	0.2	0.5	50	0.1	10	
11100037777	2.5-25	0.5	0.5	125	0.1	25	
11100047777	5.0-50	1.0	0.5	250	0.1	50	
							Reagent Bottle (Brown, 1L, Options)
							Filling tube(m)
							Discharge tube(m)



## DispensMate Dispenser Chemical Compatibility at 20°C

The devices of *Dragonlab-DispensMate* which contact with dispensed liquid consist of BSG, PTEF, FEP, and closure cap of outlet is PP; non contact liquids parts consist of PC and other materials. Please note that these tables are just a directional guide not the manufacturer's commitment. Please read the user manual carefully before use and to do related experiments necessarily, which can be used to determine whether should be used. Good laboratory practice would be to rinse out the liquid handing unit at the end of each day with distilled water to prevent corrosive liquids being left in contact with the parts for too long.

CHEMICAL	BSG	PTFE	FEP	PC	PP
<b>Acids</b>					
Acetic, Glacial	R			NR	R
Acetic, 25%	R	R	R	R	R
Hydrochloric, Concentrated	R				
Hydrochloric, 20%	R	R	R	SR	R
Sulphuric, concentrated	R				
Sulphuric, 25%	R	R	R	R	R
Nitric, Concentrated	R				
Nitric, 30%	R	R	R	R	SR
Phosphoric, 25%	R	R	R		
Formic, 25%	R	R	R		
Trichloroacetic, 10%	R	R	R	SR	SR
Formic Acid, 85%	R	R	R	R	R
Arsenic Acid	R				
Boric Acid, 10%	R	R	R	R	R
Chromic Acid, 10%	R	R	R	R	R
Hydrofluoric Acid, 35%	NR	Exceptions	R	NR	R
Phosphoric Acid 85%	R	R	R	R	R
Nitric Acid, 50%	R	R	R		
Sulphuric Acid, 95%	R	R	R	NR	NR
<b>Alkalies</b>					
Ammonium Hydroxide, 25%	R	R	R	NR	R
Potassium Hydroxide	R	R	R	NR	R
Sodium Hydroxide	R	R	R	NR	R
<b>Alcohols</b>					
Methanol, 98%	R	R		R	R
Ethanol, 98%	R			R	R
Ethanol, 70%	R			R	R
Isopropanol, n-Propanol	R			R	R
Amyl Alcohol, Butano	R				
Benzyl Alcohol	R	R	R	SR	SR
Ethylene Glycol	R	R	R	R	R
Propylene Glycol	R	R	R	R	R
Glycerol	R	R	R	R	R
<b>Hydrocarbons</b>					
Hexane, Xylene	R	R	R	NR	R
Toluene, Benzene	R	R	R	NR	SR
Kerosene, Gasoline	R				
Tetralin, Decalin	R				
<b>Halogenated Hydrocarbons</b>					
Methyl Chloride	R			NR	SR
Chloroform	R	R	R	NR	NR
Trichloroethylene	R	R	R	NR	NR
Monochlorobenzene, Freon	R				
Carbon Tetrachloride	R	R	R	NR	NR
<b>Ketones</b>					
Acetone	R	R	R	NR	R
Methyl Ethyl Ketone	R	R			
Isopropylacetone	R				




**Notes:**

1. **Hydrochloric acid** – in the presence of oxidising may cause slight attack on prolonged boiling
2. **Sulphuric acid** – will dull the surface with prolonged heating at above 250°C
3. **Nitric acid (fuming)** – may dull the surface with prolonged heating
4. **Phosphoric acid** -- may dull the surface with prolonged heating
5. **Potassium hydroxide** – the fused salt will cause slight attack
6. **Sodium hydroxide** – the fused salt will cause slight attack
7. **Hydrogen peroxide 30%** - in the presence of hydrochloric acid may cause slight attack on prolonged boiling
8. **Ammonia** – heating in an ammonia atmosphere will darken and dull the surface, leading to a porous crystalline appearance.
9. **Chlorine** – in the presence of hydrochloric acid may cause slight attack on prolonged boiling
10. **Potassium permanganate** – in the presence of hydrochloric acid may cause slight attack on prolonged boiling
11. **Sodium carbonate** – the fused salt may cause slight attack
12. **Mercury** – will readily attack at any temperature
13. **Silver nitrate** – the fused salt may cause slight attack and discolour the surface
14. **Organic compounds** – there is no data available on most of the organic compounds listed, it is unlikely they would have any detrimental effect but we can give no guarantee to this statement



## UniSampler with hose

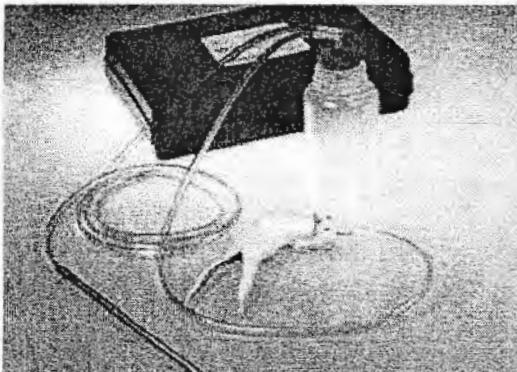

UniSampler with PVC hose and hose weight made of stainless steel. For deep, hard-to-reach places. The mass of the metal tube drags the hose to any depth.

- ▶ Suction hose PVC, 2.50 m long
- ▶ Complete in a handy transport case incl. sample bottle PP 1000 ml, vacuum pump, universal bottle adapter, hose weight made of V2A, 20 seal-it bottle seals

Universal bottle adapter made of PVC, for bottle necks Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm and 50 mm nominal dimension, for sample bottles 100 - 1000 ml

### Use

1. Lower the suction hose to the required depth.
2. Attach the adapter to the sampling bottle.
3. Create a vacuum using the handpump and collect the sample.
4. Remove the filled sample bottle, close and label it.

### UniSampler with hose


Price €	Quantity scale from	Scale price €	Item no.
	5		5314-2000 N4

### Accessories

Description	Price €	Item no.
Suction hose for replacement PVC, 2,5 m		5314-2002 N4
Sampling bottle PP, 100 ml		0319-0100 N3
Sampling bottle PP, 250 ml		0319-0250 N3
Sampling bottle PP, 500 ml		0319-0500 N3
Sampling bottle PP, 1000 ml		0319-1000 N3

*3d* 

## UniSampler "Ex"

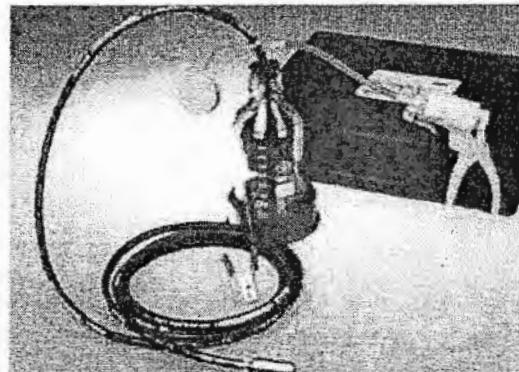

Sampler especially developed for sampling flammable liquids of Hazard Category A1 (VbF, e.g. fuel). Glass bottle and hose are connected in such a way that they conduct electricity and are earthed via an earthing cable.

- ▶ Complete in a handy transport case incl. 4m hose (NBR), glass bottle 1000 ml, bottle adapter, vacuum pump, earthing cable and hose-weight made of brass
- ▶ PTB approval D-333-009 618/00

### Use

1. Earth the device.
2. Lower the suction hose to the required depth.
3. Attach the adapter to the sampling bottle.
4. Create a vacuum using the handpump and collect the sample.
5. Remove the filled sample bottle, close and label it.

 The UniSampler "Ex" was developed in co-operation with the quality association Tankschutz e.V. (non-profit association for tank protection).

### UniSampler "Ex"

Price €	Quantity scale from	Scale price €	Item no.
	5		5314-3000 N4

### Accessories

Description	Price €	Item no.
Glass sampling bottle 1000 ml, GL 45		5314-0100 N3



Kavalierglass of North America, Inc. > technical glass > laboratory glass > bottles

## Reagent bottles with screw GL 45 acc. to DIN—complete, marked SIMAX



Number	PCN	EAN	Code	Capacity/ml	d/mm	h/mm	G
2070 M	10	8593419604080	1632414321100	100	56	100,00	45
2070 M	10	8593419604095	1632414321250	250	70	138,00	45
2070 M	10	8593419604102	1632414321500	500	86	176,00	45
2070 M	10	8593419604119	1632414321940	1000	101	225,00	45
2070 M	10	8593419604125	1632414321950	2000	136	260,00	45
2070 M	6	8593419604133	1632414321956	5000	186	330,00	45
2070 M	1	8593419604140	1632414321966	10000	234	410,00	45
2070 M	1	8593419715563	1632414321968	20000	299	505,00	45

### Related items:

Reagent bottles with  
screw GL 45 acc. to  
DIN—complete,  
marked SIMAX, no cap



Bottles, reagent  
bottles, screw  
GL 45 acc. to  
DIN—complete,  
marked SIMAX, no cap



Reagent bottles with  
screw GL 45 acc. to  
DIN—complete,  
marked SIMAX, no cap




Reagent bottles with  
screw GL 45 acc. to  
DIN—complete,  
marked SIMAX, no cap



View details and buy online



RA  
GUNA  
2012



Enter search term

4-0053 

## Rack for Centrifugation Tubes

↳ Product groups → Storage, Transport → Centrifuge Tube Racks

neoLab

Keyword Index

Direct enquiry:  
Enter here

neoLab Shop

Enter part no.

This rack is made of ABS and is designed for 15ml and 50ml conical tubes. Alphanumeric index aids for tube identification.

About us

Service

Part no.

Capacity

Measures

Price

Cart Favourites

4-0053

30 x 15ml and 20 x 50ml


209 x 171 x 63 mm

Terms of Delivery  
and Payment

Capacity: 30 x 15ml and 20 x 50 ml tubes.

27.05.2016 r.

## neolab for my lab : Rack for Centrifugation Tubes



Enter search term

4-0043

GO

Keyword Index

Individual order taking from: Mo-Do 7.30-18.00 h, Fr 7.30-16.00 h | Tel. +49 (0)6221 8442-44

Deutsch

Contact

Laboratory Equipment · Life Science · Chemicals

neoLa

## Rack for Centrifugation Tubes

↳ Product groups → Storage, Transport → Centrifuge Tube Racks

## Rack for Centrifugation Tubes

 Direct enquiry:  
Enter here

neoLab Shop

Enter part no.

About us

Service

 Terms of Delivery  
and Payment

More pictures

 Additional  
information

Matching parts

Location

 Professional  
advisory

Tip



This rack is made of ABS and is designed for 15ml and 100ml conical tubes. Alphanumeric index aids for tube identification.

Capacity: 30 x 15ml and 20 x 100ml

Part no.

4-0043

Capacity

30 x 15ml and 20 x 100ml

Measures

209 x 171 x 63 mm

Price


Cart

Favourites

www.my  
neolab.de

A 12


## Flask tongs

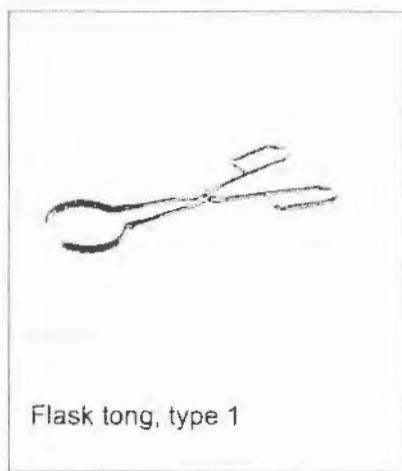

Points polyamid coated

Flask tong, type 1


Material	A (Length)	a (Length)	d/Ø	D/Ø	Type	Article no.
18/10 E-Poli	250	110	20	5	1	2179
18/10 E-Poli	250	115	30	5	1	2180
18/10 E-Poli	250	130	40	5	1	2181
18/10 E-Poli	250	135	50	5	1	2182
18/10 E-Poli	250	145	60	5	1	2183
18/10 E-Poli	230	115	15/60	5	2	2250





# Filtres Fioroni

Fioroni Filters - since 1876

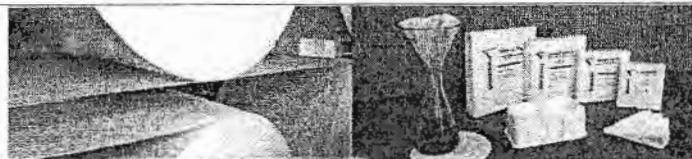[Fioroni](#)[Search](#)[Contact us](#)

## ▼ Menu

- [Glycol and oil separator](#)
- [Pump](#)
- [Filter](#)
- [Electrolytic filter](#)
- [Other papers](#)
- [pH indicator papers](#)
- [IT-SIS](#)



Reagent papers



Indicator papers




Other



Liquid Indicator

## pH test strips

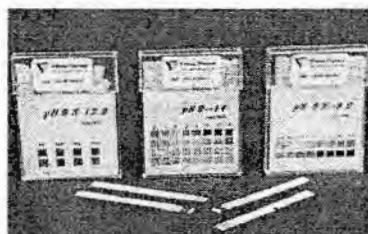

## Applications

- Schools / universities
- Aquaculture
- Hospitals / research laboratories
- Fire brigades / scientific police
- Chemical industry
- Soil analysis
- Dairy industry
- Surface treatment industry

## Grade 1010

The non-bleeding pH test strips allow a rapid reading and are suitable for measuring pH of solutions weakly buffered or strongly alkaline.

### Packaging:

- Transparency plastic box with:
- 100 strips 6 x 80 mm + colour chart

[Information to order](#)


Filtres Fioroni  
15, rue Pierre et Marie  
Curie - 45140 Ingré



Tel : (+33) 02 38 43 22 63  
Fax : (+33) 02 38 43 00 22  
[contact@filtres-fioroni.com](mailto:contact@filtres-fioroni.com)

Realisation : IT-sis  
[www.it-sis.com](http://www.it-sis.com)

## Advantages

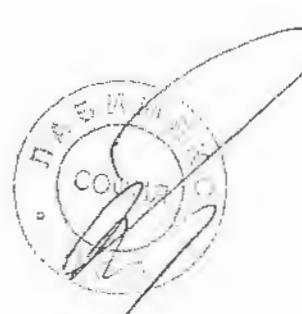



# Filtres Fioroni

Fioroni Filters - since 1876



Fioroni

Search

Contact us



## ▼ Menu

- [Home page](#)
- [Products](#)
- [Filtration](#)
- [Other products](#)
- [Technical filters](#)
- [Pore size chart](#)
- [Technical papers](#)
- [Industrial filters](#)
- [pH indicator papers](#) ◀
- [Filtration accessories](#)
- [Technical filters](#)
- [Technical training](#)



Reagent papers



Indicator papers



Liquid indicator

## pH indicator papers

The non-bleeding pH test strips allow a rapid reading and are suitable for measuring pH of solutions weakly buffered or strongly alkaline.

### Packaging:

- Transparency plastic box with:  
100 strips 6 x 80 mm + colour chart

[Information to order](#)

### Advantages

**No bleeding of dyes** because they are fixed to the cellulose fibers

**This protect the solution against contamination** and allows further measurements

**Reliable pH measurements** even in weakly buffered solutions. The test strip can leave in the solution until the final reaction colour is obtained.

**High easily pH readings** because the different test colours are enough separated on the strip

**The stiffness of the plastic pH strip** enables a best handling

### Scale value

pH 0 -14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH 0,5 -5	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
pH 5,5 -9	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9							
pH 9,5 -13	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13							

Filtres Fioroni  
15, rue Pierre et Marie  
Curie - 45140 Ingré



Tel (+33) 02 38 43 22 63  
Fax (+33) 02 38 43 00 22

[contact@filtres-fioroni.com](mailto:contact@filtres-fioroni.com)

Réalisation : iT-sis  
[www.it-sis.com](http://www.it-sis.com)



**Information to order**

Grade

1010

pH 0 -14	1010F00021
pH 0.5 -5	1010F00023
pH 5.5 -9	1010F00024
pH 9.5 -13	1010F00025



15, rue Pierre et Marie Curie

45140 Ingré


**contact@filtres-fioroni.com**

Tél. : (+33) 02 38 43 22 63

Fax : (+33) 02 38 43 00 22



## Spoon spatulas

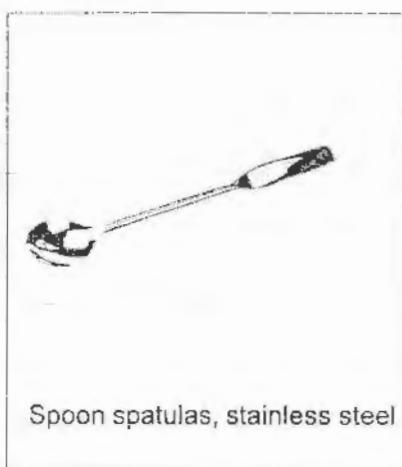

Spoon spatulas, stainless steel

Material	A (Length)	a (Length)	B (Width)	D/Ø	F x E	Article no.
18/10 Stainless	120	35	10	5	30x22	3470
18/10 Stainless	150	40	10	5	30x22	3471
18/10 Stainless	180	50	12	5	40x29	3472
18/10 Stainless	210	50	12	5	40x29	3473
18/10 Stainless	250	70	14	5	48x35	3474
18/10 Stainless	300	70	14	5	48x35	3475

*[Handwritten signature]*

# AUXILAB S.L.

Material de laboratorio

Instrumental · Labware · Consumables

Also consult:

Bargains

New products

Clearance sales

keep you inform about our offers and news:

Subscribe to bulletin

Prices are shown without VAT.


Consults

4 948 310 513

## Drying rack, 55 places

Nahita



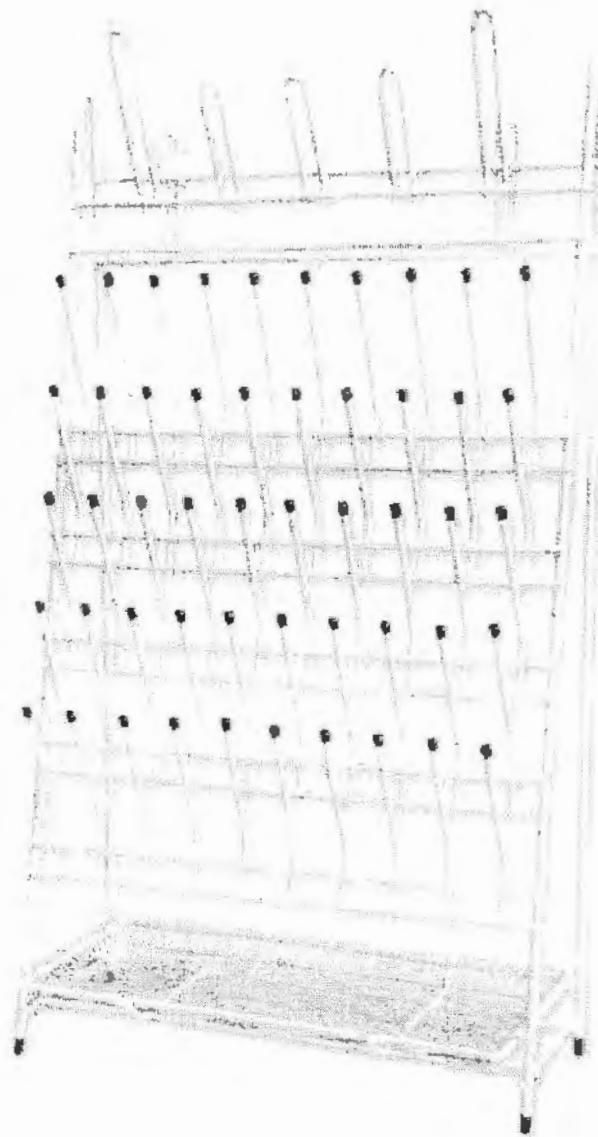

## Specifications

Ref.: 63224750

- Made of plastic coated steel
- ideal for drying different materials
- can be used as desktop or hanged
- Lower shelf for dripping water
- 55 hangers
- Dimensions 640x360x140mm

## Alternative products



Drying rack, 32 places





[Home](#) [Contact](#) [Privacy](#) [Terms & Conditions](#) [Log in](#)

# Online-Catalog

Product groups

Liquid Handling

Life science products

Volumetric Instruments

Density

Clinical Lab.

General Laboratory

PARAFILM® M Sealing film

Erlenmeyer flasks

Beakers and jugs

Container

PFA-products

PTFE-products

Magnetic Stirring Bars

Magnetic stirring bar retriever

PTFE Stopcocks, Beakers, Bolides

Funnels, filters

Desiccators

Gas wash bottles / sampling tubes

Waterjet Pumps

Tub., Connect, Stopc.

Stoppers, caps, closures

Stirrers, stirring bars etc.

Scoops, Forceps etc.

Bottles / aspirator bottles

Rinsing systems, draining racks

Racks

Water stills

Universal Detergents

disinfecting Detergents

Scaffolding components

## Magnetic stirring bar retriever

Cat. No.: 137710

### Product description

PTFE. Magnetic core fully sealed

### Minimum order quantity / quantity interval

1 piece

### Specification

length

mm

250

Ø

mm

8

### Short description / Minimum order quantity, quantity interval

Magnetic stirring bar retriever 250x 8 mm PTFE

1 piece

\* Recommended sales price without VAT (PL 2016)

Add Cat. No. 137710 to my note list

Price per From Unit price\*

1 piece/s 1

Search for Cat.No./text

Product finder

Search

Step-by-Step search

Language selection

Options

Print

Create PDF

My note list



3.12

3.27

## Medical grade silicone tubing. Non toxic

Medical grade silicone. For use in a variety of medical, pharmaceutical, industrial and clinical applications. Translucent tubing. Very high mechanical and chemical resistance. Silicone tubing has a chemical composition similar to quartz and glass and share their excellent properties.  
Autoclavable.

### Technical features:

Specific gravity: 1.2 - 0.1

Toughness: 40 - 80 Sh

Resistance to traction: 77-95 kg/cm


Extension: 275-780%

Resistance to tearing: 20-50 kg/cm<sup>2</sup>

Temperature range: -50 °C to 200 °C (breaks at 250 °C)

code	dimensions mm Ø int. x Ø ext.	bag quantity (meters)	bag weight	bag volume
350051	0.5 x 1	1 x 100	0.06	0.0011
350115	1 x 1.5	1 x 100	0.21	0.004
350013	* x 3	1 x 15	0.12	0.001
350024	2 x 4	1 x 15	0.21	0.002
350034	3 x 4	1 x 15	0.21	0.004
350035	3 x 5	1 x 15	0.25	0.002
350037	3 x 7	1 x 15	0.49	0.003
350046	4 x 6	1 x 15	0.50	0.002
350048	4 x 8	1 x 15	0.77	0.004
350057	5 x 7	1 x 15	0.34	0.003
350059	5 x 9	1 x 15	0.66	0.004
350069	6 x 9	1 x 15	0.61	0.01
350610	6 x 10	1 x 15	0.92	0.009
350612	6 x 12	1 x 15	0.21	0.004
350079	7 x 9	1 x 15	0.57	0.009
350710	7 x 10	1 x 15	0.69	0.007
350810	8 x 10	1 x 15	0.62	0.009
350812	8 x 12	1 x 15	1.09	0.005
350814	8 x 14	1 x 15	1.84	0.007
350912	9 x 12	1 x 15	0.81	0.012
350915	9 x 15	1 x 15	0.21	0.004
351014	10 x 14	1 x 15	1.39	0.008
351420	11 x 20	1 x 15	2.72	0.024
351622	15 x 22	30	2.09	0.064
352000	20 x 30	30	14.70	0.098

NOTE: Tube thickness =  $\frac{\text{external Ø} - \text{internal Ø}}{2}$

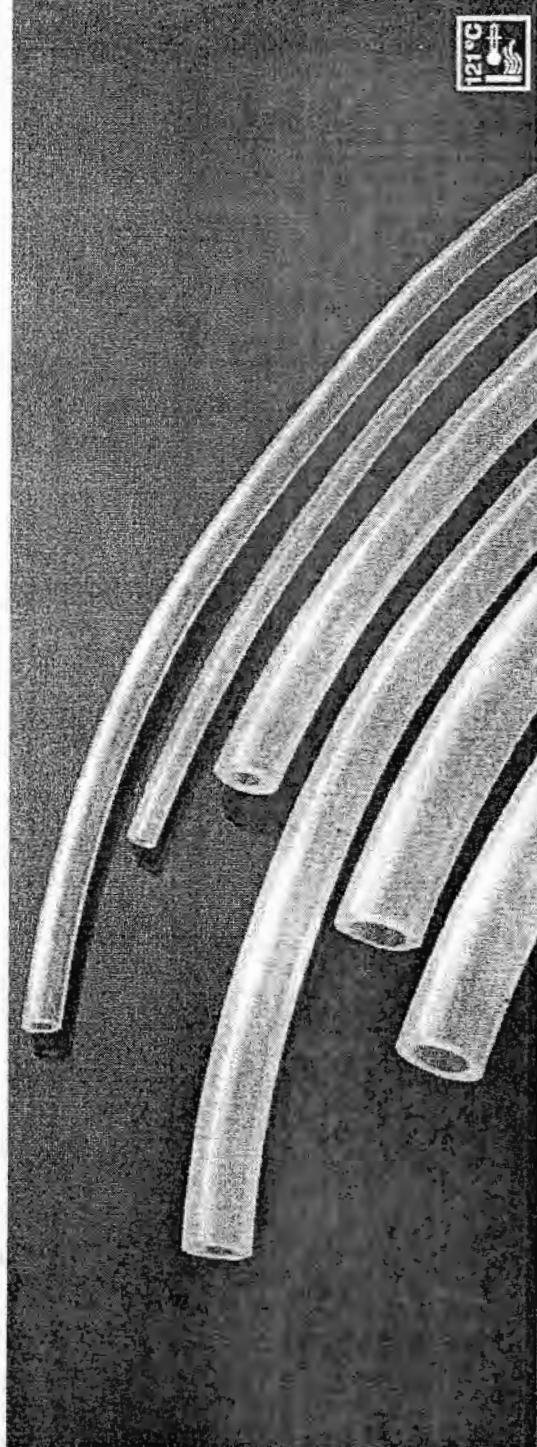


## Tubing clamps

Material: autoclavable acetal

These clamps will not distort, rust or corrode. Different positions to control flow from full open to complete closure.


code	description	bag quantity	bag weight	bag volume
19505	for tubes of 3.2 to 11 mm (15 positions)	12	0.06	0.0005
19504	for tubes of 11 to 19 mm (12 positions)	6	0.09	0.0007

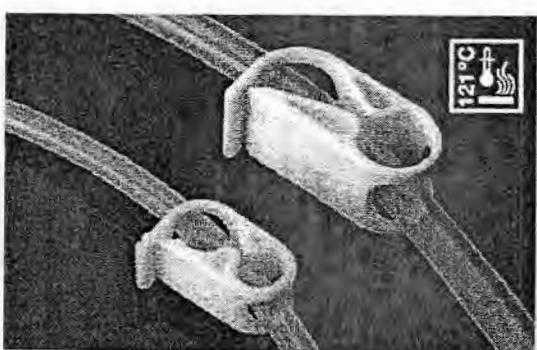

**deltalab**

HYGIENE, SAFETY AND GENERAL LABWARE

269

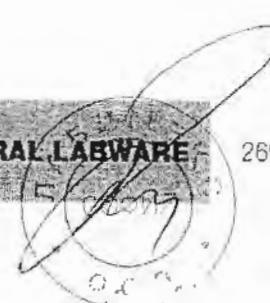

5.13




---

Personalized PDF Catalog  
Catalogue Generated 27 Май 2016 г.

---



DENE3011521		15,0 mm	21,0 mm	3,0 mm	25 m
DENE3011622		16,0 mm	22,0 mm	3,0 mm	1 m
DENE3012028		20,0 mm	28,0 mm	4,0 mm	1 m
DENE3012533		25,0 mm	33,0 mm	4,0 mm	25 m
228-3820		10,0 mm	14,0 mm	2,0 mm	25 m
228-3821		12,0 mm	17,0 mm	2,5 mm	25 m
228-3822		18,0 mm	24,0 mm	3,0 mm	25 m
228-3334		3,0 mm	6,0 mm	1,5 mm	1 m
228-3812		4,0 mm	6,0 mm	1,0 mm	25 m
228-3813		5,0 mm	8,0 mm	1,5 mm	25 m
228-3344		5,0 mm	8,0 mm	1,5 mm	1 m
228-3815		6,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	25 m
228-3814		6,0 mm	9,0 mm	1,5 mm	25 m
228-3346		6,0 mm	9,0 mm	1,5 mm	1 m
228-3816		7,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	25 m
228-3817		7,0 mm	11,0 mm	2,0 mm	25 m
228-3356		7,0 mm	11,0 mm	2,0 mm	1 m
228-3818		8,0 mm	12,0 mm	2,0 mm	25 m
228-3819		9,0 mm	13,0 mm	2,0 mm	25 m





23

# Kartell

## GLASS FIBER SPATULAS

Made according to DIN 12890. A range of robust, inexpensive general purpose spatulas. Excellent chemical resistance.

Scraper plus spoon or double scraper configuration. Suitable for use in food and beverage industry. Autoclavable. Suitable for food contact. (NSF/ANSI STANDARD 51).

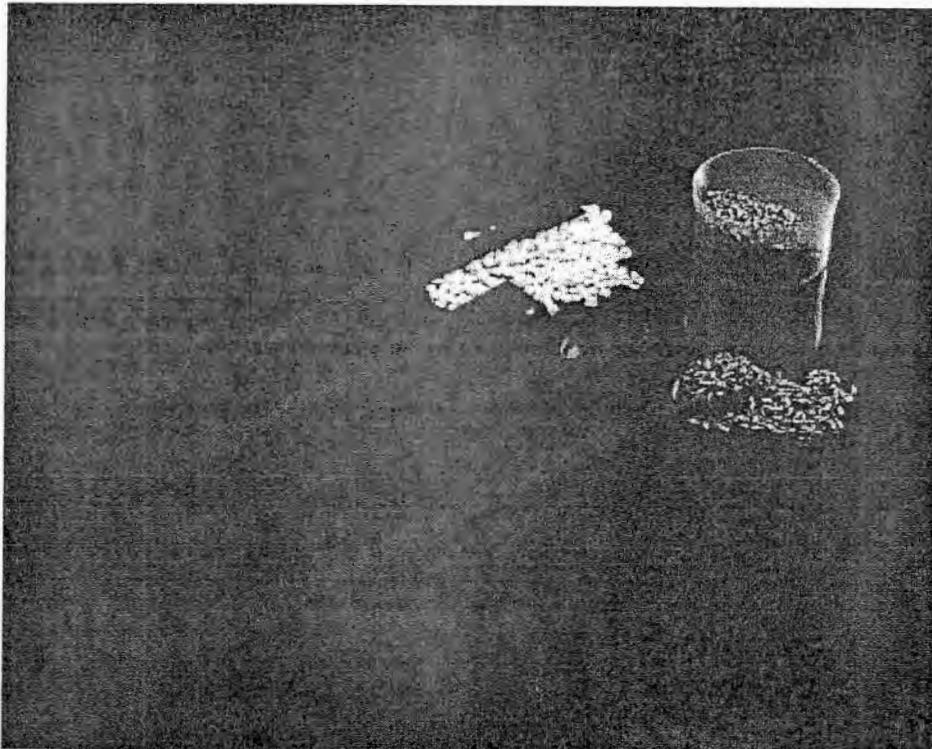

### Material:

GLASS FIBRE NYLON


[Download PDF](#)

[View More](#)

Art.	Type	Length/Width
594	Flat ends	150/18/20
595	Flat ends	180/20/22
596	Spoon ends	180/1,5



...OK

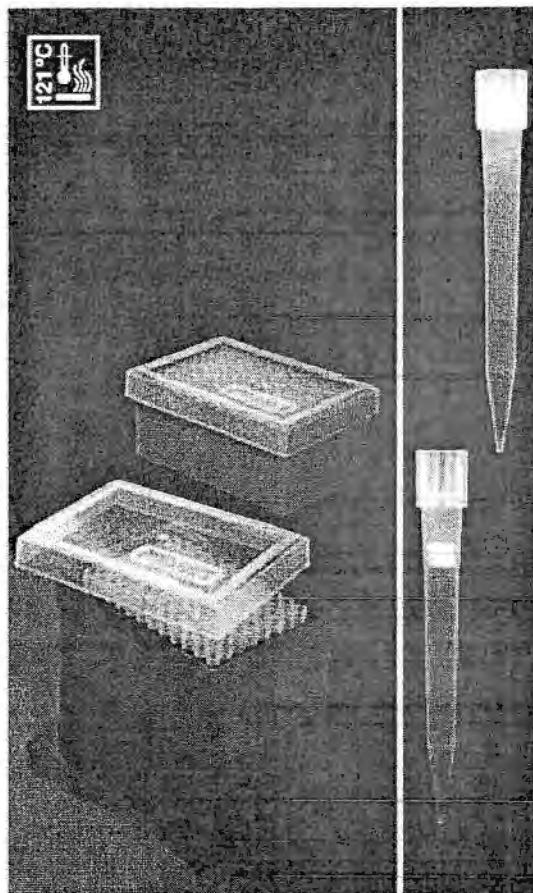**20 - 300 µl tip**

Natural colour universal tip, Eppendorf® type.

**Suitable (not exclusive)**

Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Biohit®, Elkay®, Jencons®, Finnpipette®, Nichiryo®, Socorex®.

Rack made of autoclavable (up to 121 °C) polypropylene.


Racks with transparent lid and base in different colours.

Rack without filter: blue base.

STANDARD filter: red base.

code	description	sterile	case quantity	case weight	case volume
200077	bags in bulk	no	20 x 1,000	9.7	0.071
200077R	96 tips rack	no	10 x 96	1.94	0.009
200077F	filter tips in bags	no	20 x 1,000	9.9	0.071
● ■ 200077FR	96 tips rack filter	■	10 x 96	1.92	0.009

Tips in bulk: minimum unit sale: 1 bag.

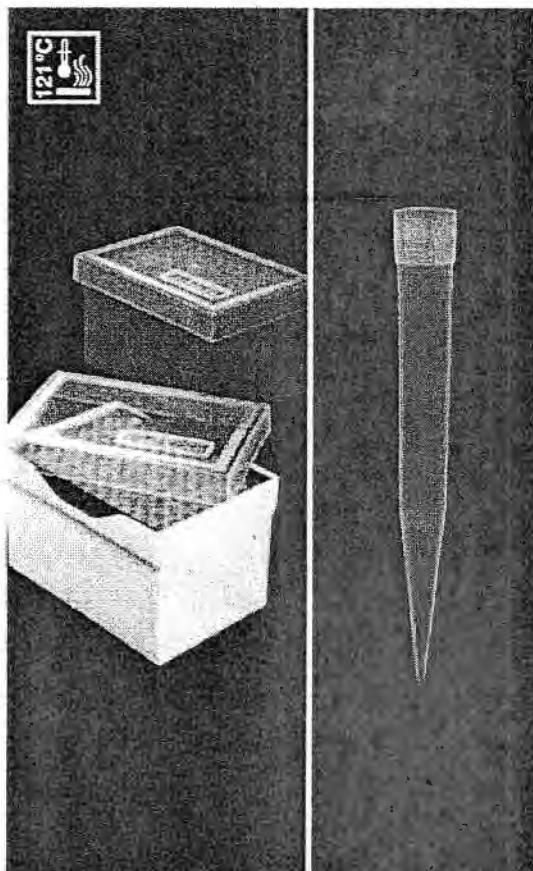**100 - 1,000 µl tip**

Universal tip with collar. Blue or natural colour.

**Suitable (not exclusive)**

Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, DSG®, Elkay®, Finnpipette®, Genex®, Jencons®, Nichiryo®, Suitable for Menarini®.

Rack made of polypropylene, autoclavable up to 121 °C.

Racks with transparent lid and base in different colours depending on the model.

Tips without filter: blue base.

STANDARD filter: red base.

EXTRA filter: white base.

code	description	sterile	case quantity	case weight	case volume
<b>Blue colour:</b>					
200012	bags in bulk	no	10 x 1,000	8.4	0.085
200012B	single tips individually wrapped	■	175	0.27	0.0035
200012R	96 tips rack	no	10 x 96	2.36	0.009
<b>Natural colour:</b>					
200070	bags in bulk	no	10 x 1,000	8.0	0.080
200070R	96 tips rack	no	10 x 96	2.4	0.009
● ■ 200070NR	96 tips rack	■	10 x 96	2.38	0.010
327-30	filter bags in bulk	no	10 x 1,000	3.5	0.063
327-30R	96 tips rack filter	■	10 x 96	2.38	0.013
327-30RX	96 tips rack EXTRA filter	■	10 x 96	2.4	0.015

Codes 200070 and 327-30 minimum unit sale: 1 bag.

**Colour codes:**

- RNAse and DNase free
- Metal free
- Pyrogen free


**deltalab****LIQUID HANDLING***AK*

3.16

# Kartell


## BOTTLE-CARRIERS

Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 95 mm and 120 mm respectively (corresponding to 1 liter bottle Kartell art. 412-325-3251-1616- 1629-1603 and 2 liters bottle Kartell art 413-326-3261). Both of them, made of PP, feature an ergonomic design of the handle and can be easily stacked.

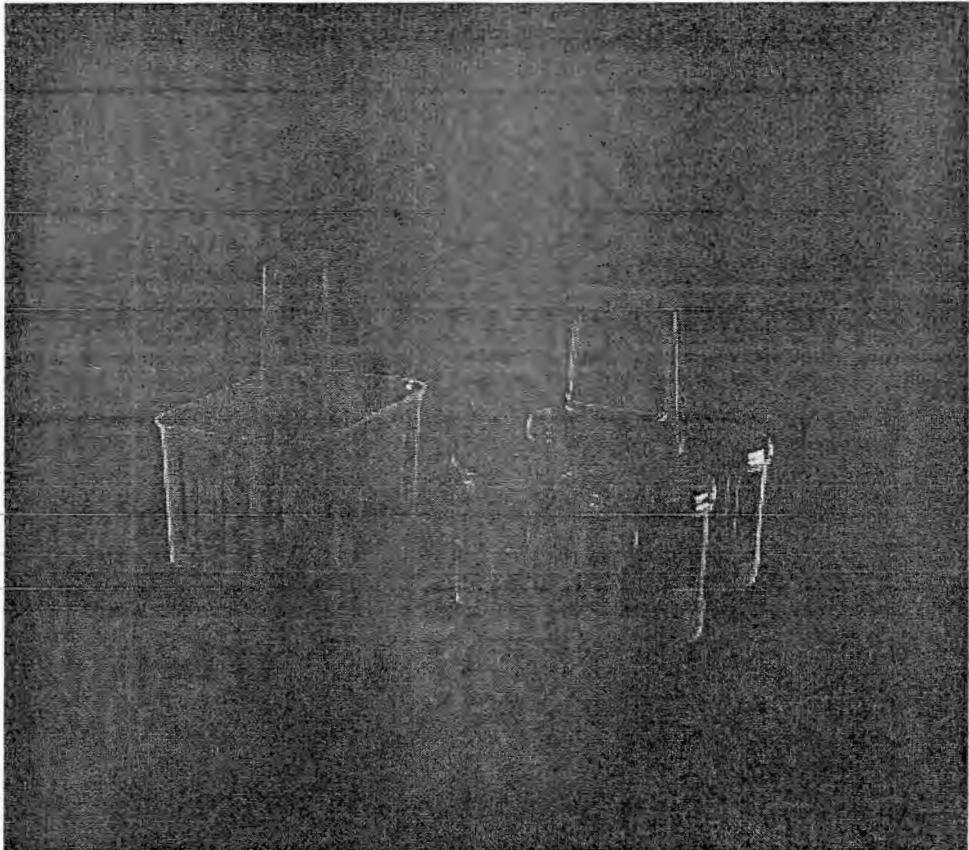

Material:

PP



[Download PDF](#)


[Login](#)

[View More](#)

Art.	Places	Dim. mm
------	--------	---------

395	6	320x300x200
-----	---	-------------

396	4	310x300x270
-----	---	-------------

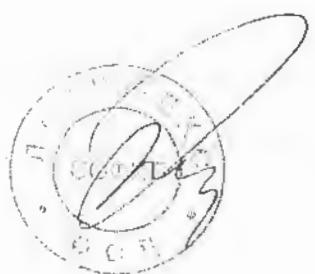

A


3.17  
3.22



---

Personalized PDF Catalog  
Catalogue Generated 27 Май 2016 г.

---



А.А.

VWR Catalog Number	Price	Quantity	Description	Capacity	Drop vol.	Length	Sterile	Packe
612-1732	€		Not graduated	0,2 ml	30 µl	130 mm	-	Bulk
612-1735	€		Not graduated	1,0 ml	20 µl	104 mm	-	Bulk
612-5472	€		Graduated	1,0 ml	14 µl	144 mm	-	Bulk
612-1776	€		Graduated	1,0 ml	56 µl	170 mm	-	Bulk
612-1740	€		Graduated	1,0 ml	40 µl	138 mm	-	Bulk
612-5471	€		Graduated	1,2 ml	40 µl	63 mm	-	Bulk
612-1762	€		Not graduated	1,5 ml	45 µl	230 mm	-	Bulk
612-5475	€		Not graduated	1,5 ml	45 µl	230 mm	+	Bulk
612-1744	€		Graduated	2,0 ml	45 µl	155 mm	-	Bulk
612-1746	€		Graduated	3,0 ml	40 µl	150 mm	-	Bulk
612-1755	€		Not graduated	3,0 ml	33 µl	150 mm	-	Bulk
612-5474	€		Graduated	3,0 ml	40 µl	155 mm	+	Bulk
612-1774	€		Not graduated	10,0 ml	56 µl	170 mm	-	Bulk
612-5473	€		Not graduated	10,0 ml	45 µl	300 mm	-	Bulk

COPPIA

a



A part of Merck

All

Search product, CAS, keyword...

Login | Register

0  
Cart

Products | Services | Documents | Responsibility | Support | About Us

Home &gt; Analytics and Sample Preparation &gt; Test Kits and Photometric Methods &gt; Visual Tests for Semi-quantitative Analyses &gt; pH-Tests &gt; pH-Indicator Strips (non-bleeding) &gt; pH-indicator strips pH 0 - 2.5

## 109540 | pH-indicator strips pH 0 - 2.5

non-bleeding pH 0 - 0.5 - 1.0 - 1.3 - 1.6 - 1.9 - 2.2 -  
2.5 MColorpHast™

109540

[View Pricing & Availability](#)

- [SDS](#)
- [Brochures](#)
- [Instructions for Use](#)
- [CoA](#)
- [Application Notes](#)

[Click To Print This Page](#)

Overview | Supporting Documentation | Related Products &amp; Applications

### Overview

[Replacement Information](#)  
[Description](#)  
[Product Information](#)  
[Safety Information according to GHS](#)  
[Storage and Shipping Information](#)  
[Pricing & Availability](#)

#### Replacement Information

Replacement Information	In North America 1.09540.0001 replaces and is identical to 9580-1 In North America 1.09540.0001 replaces 9580-3, identical product but single pack
-------------------------	---

#### Pricing & Availability

Catalogue Number	Availability	Packaging	Qty/Pack	Price	Quantity	Add To Favorites
1095400001	—	Plastic box	100 strips	Upon Order Completion	—	<a href="#">Contact Customer Service</a>


[Add To Cart](#)

#### Description

Catalogue Number	109540
Replaces	9580-1; 9580-3; 9580
Synonyms	9580-1, 9580, 9580-3
Overview	The pH tests are suited for all media in environmental analysis and in industrial in-process controls. Our special method of manufacture gives the pH indicator stripes decisive advantages over the indicator paper: since the indicator does not bleed, the stripe can be left in the measurement medium without contaminating it.

#### Product Information

HS Code	3822 00 00
---------	------------



**Safety Information according to GHS**

Storage class 10 - 13 Other liquids and solids

**Storage and Shipping Information**

Storage Store at +15°C to +25°C.

**Recently Viewed**

pH-Indicator strips pH 0 - 2.5  
non-bleeding pH 0 - 0.5 - 1.0 - 1.3 -  
1.6 - 1.9 - 2.2 - 2.5 MColorpHasl™

**Recommended Products**

pH-indicator  
strips pH 4.0 - 7.0



pH-indicator  
strips pH 0 - 14  
Universal  
indicator



pH-indicator  
strips pH 0 - 6.0

**PRODUCTS**

Products by Application  
Products by Brand  
Products by Industry  
Products by Type  
Ordering our Products

**SUPPORT**

Help  
Feedback  
Cookies  
Customer & Tech Service FAQ  
Patents  
Contact Us

**COMPANY**

About Us  
News  
Events  
Careers  
Change Country

**Research, Development, Production**

We are a leading supplier to the global Life Science industry: solutions and services for research, development and production of biotechnology and pharmaceutical drug therapies.



[Merck Group](#) | [Imprint](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Statement](#) | [Conditions of Sale](#)

Copyright © 2016 Merck KGaA. All rights reserved.  
Merck Millipore is a part of Merck.







## close-it control seal | essential for sampling

Taking samples from sacks, boxes, bags, etc. with sampling lancets is a common and time-proven practice. This produces holes through which easily flowing bulk goods could escape from the container. With the close-it seal, this can be prevented in an uncomplicated manner.

to most commercial containers, even to surfaces coated with fine powder, slightly moist or even frozen surfaces where conventional labels or adhesive tape will not stick.

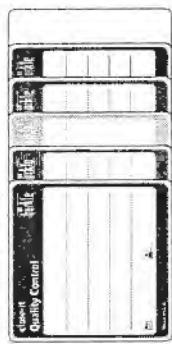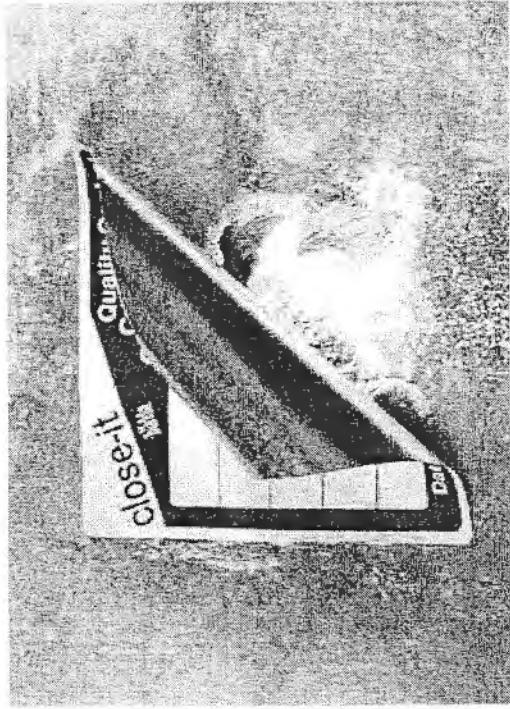

close-it has been especially developed for this purpose. The label has a sandwich-type structure (aluminium paper) and seals the container hermetically (vapour barrier). This virtually prevents hygroscopic powders from clumping together. The label is not just used to provide a hermetic seal. It is also used for providing quality control information (sampling date, release yes/no, name of tester, etc.). The labels are available in different colours. With printing in red, blue, green, yellow, black, neutral, without printing in white.

close-it can be written on with ball-point pen, pencil or felt-tip marker.

The rear of the label is coated with a powerful adhesive. This means that close-it sticks firmly

### Control seal close-it 95x95

Colour	Model	W x H mm	Pieces per roll	Price €	Quantity scale from	Scale price €	Item no.
red	printed	95 x 95	500	51.00	10	51.00	5303-0018 N4 — 1/2
yellow	printed	95 x 95	500	51.00	10	51.00	5303-0014 N4
blue	printed	95 x 95	500	51.00	10	51.00	5303-0015 N4
green	printed	95 x 95	500	51.00	10	51.00	5303-0016 N4
black	printed	95 x 95	500	51.00	10	51.00	5303-0011 N4
white	unprinted	95 x 95	500	51.00	10	51.00	5303-0002 N4

### [E] Accessories

Description  
close-it dispenser for labels with 95 x 95 mm


### Control seal close-it maxi 150x150


Colour	Model	W x H mm	Pieces per roll	Price €	Quantity scale from	Scale price €	Item no.
red	printed	150 x 150	250	74.55	10	74.55	5303-1012 N4 — 2/2
yellow	printed	150 x 150	250	74.55	10	74.55	5303-1014 N4
blue	printed	150 x 150	250	74.55	10	74.55	5303-1015 N4
green	printed	150 x 150	250	74.55	10	74.55	5303-1016 N4
black	printed	150 x 150	250	74.55	10	74.55	5303-1011 N4
white	unprinted	150 x 150	250	74.55	10	74.55	5303-1002 N4

### [E] Accessories

Description  
close-it dispenser for labels with 150 x 150 mm

Price €	Item no.
81.10	5303-9000 N4



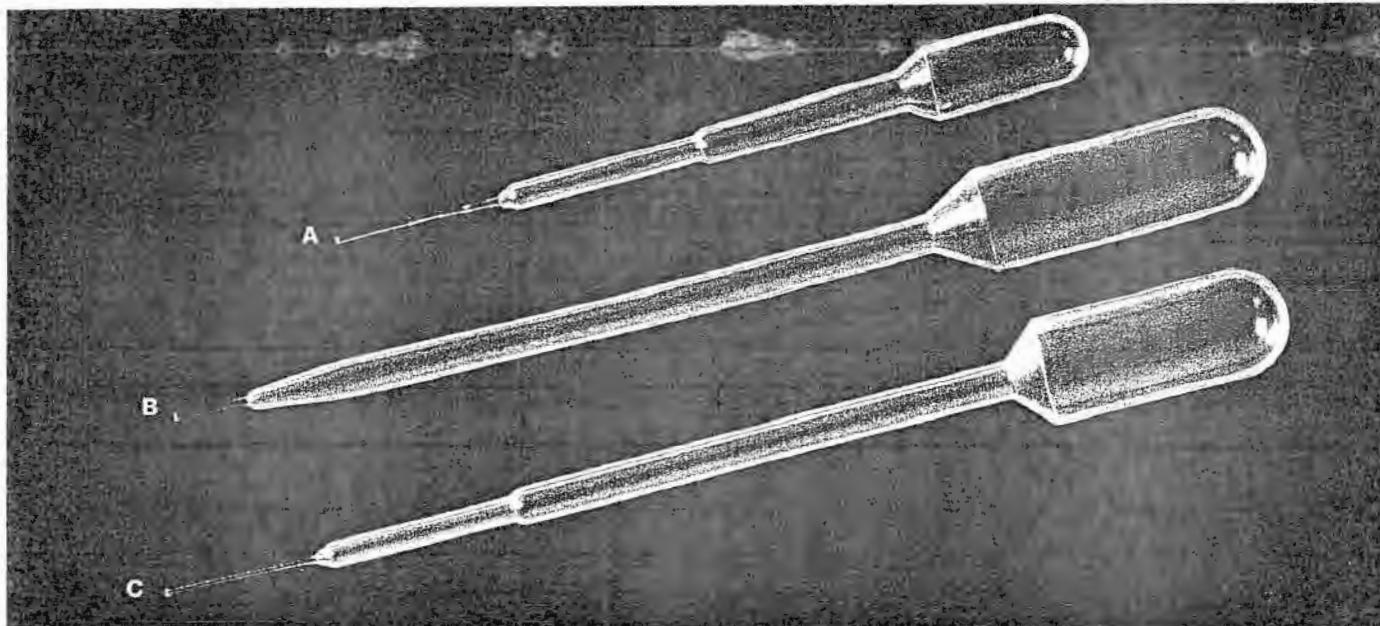


### General purpose pipettes

Made in transparent an inert polyethylene.

Sterile models are sterilized by ethylene oxide. Volumetrical tolerance:  $\pm 10\%$ .

mod	code	presentation	sterile	length mm	stem mm	total capacity ml	bulb drawn ml	case weight	case volume
A	210003	8 x 400	no	104	3.0	1.5	1.0	2.4	0.022
A	210023	500 individually wrapped peel-pack	OXIDE	104	3.0	1.5	1.0	1.38	0.021
B	210002	10 x 500	no	144	5.0	5.0	3.3	7.2	0.099
B	210022	500 individually wrapped peel-pack	OXIDE	144	5.0	5.0	3.3	1.65	0.03
C	210004	8 x 250	no	153	3.0	5.5	3.0	3.30	0.042
C	210024	500 individually wrapped peel-pack	OXIDE	153	3.0	5.5	3.0	1.62	0.03

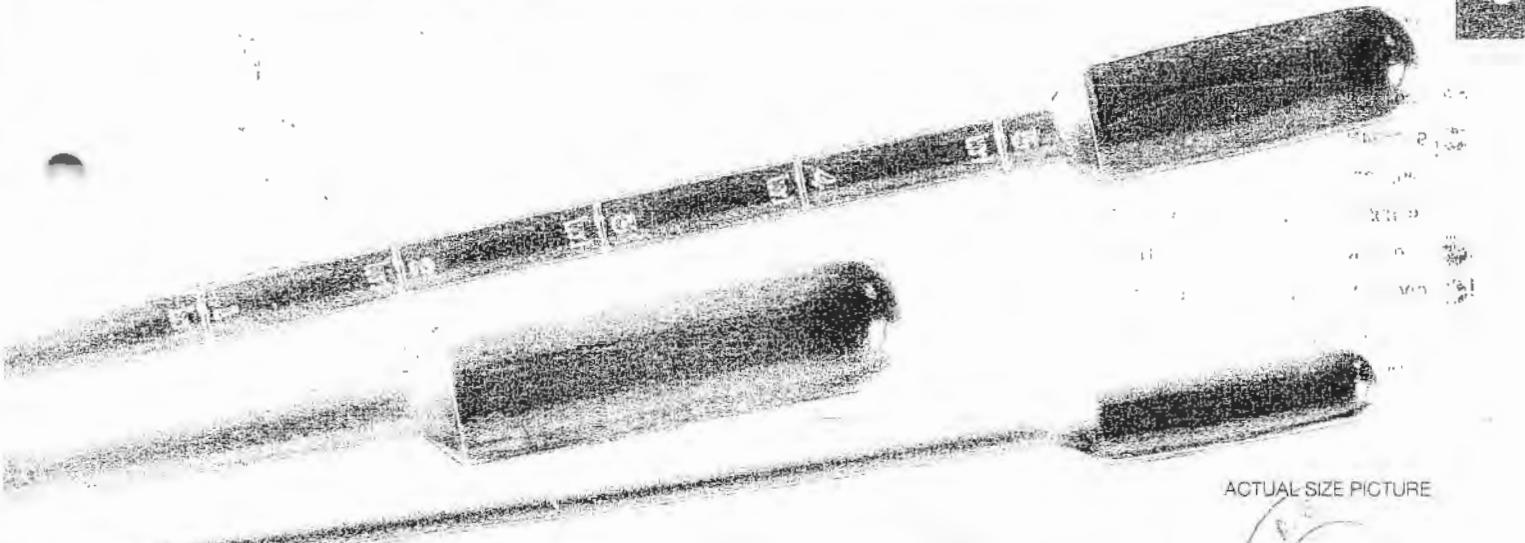


### Extra long pipettes

Made in transparent polyethylene. Model 200050 is graduated each ml up to 5 ml. Volumetrical tolerance:  $\pm 10\%$ .

mod	code	presentation	length mm	stem mm	total capacity ml	bulb drawn ml	case weight	case volume
A	200050	10 x 250	216	-	5.0	3.5	8.90	0.105
B	200060	10 x 100	300	9.0	23.0	7.1	7.3	0.105
C	210006	10 x 400	225	5.0	6.0	2.3	9.04	0.098

## PASTEUR PIPETTE

Disposable PE pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample. Non-sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped.

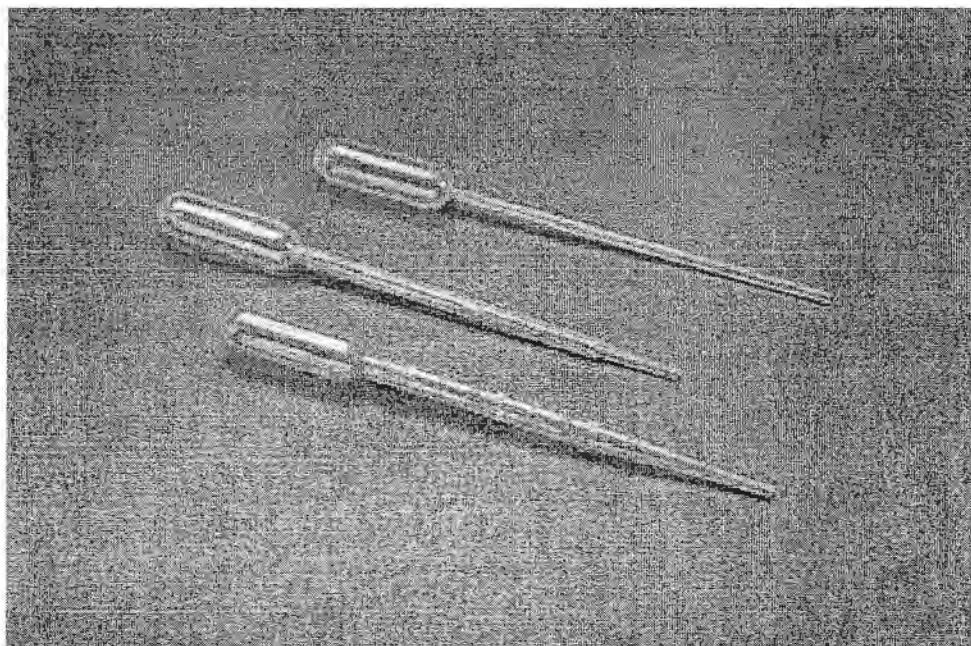

### Material:

PE

[Download PDF](#)



[Login](#)

[View More](#)

Art.	Length mm	Graduat. ml	Pkg. pcs.	Grad. ml
329	150	(Capill.)	Individual sterile	4ml (Capill.)
330	153	1	Individual sterile	0,25
334	154	3	Individual sterile	0,50
88335	153,40	(Capill.)	500	4ml (Capill.)
88336	153	1	500	0,25
- 88337	152,19	3	500	0,50

## Kartell Labware

[The Company](#)

[Products](#)

[News](#)

[Contacts](#)

## Products

[Dispolab](#)

[Liquid handling](#)

[Plastilab](#)

[Technokartell](#)

## Direct Links

[FAQ](#)

[Technical Manual](#)

[Request new password](#)


[Labware Division](#)

[Habitat Division](#)

[Museo](#)

© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 |  
LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO  
CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067

Powered by Quboblu

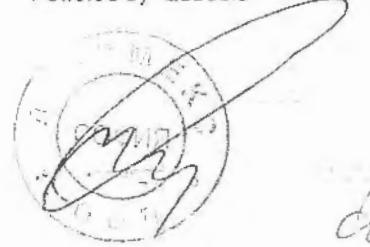

3.24


[Home](#) [Contact](#) [Privacy](#) [Terms & Conditions](#) [Imprint](#)

# Online-Catalog

[GC 900](#) » [Liquid Handling](#) » [Bottle-top dispensers](#) » [Dispensette® S](#) »

**Product groups**
[Liquid Handling](#)
[Bottle-top dispensers](#)
[Dispensette® S](#)
[scriptor®](#)
[CunkSip™ and accessories](#)
[Accessories Dispensette® S](#)
[Accessories Dispensette® III](#)
[Accessories sencette®](#)
[Bottle-top burettes](#)
[Single / Multichannel Pipettes](#)
[Pipette tips and Filter Tips](#)
[PLT unit \(Pipette Leak Testing Unit\)](#)
[Positive-displacement pipettes](#)
[Repetitive pipettes](#)
[PD Tips](#)
[Pipette controllers](#)
[Calibration Software](#)
[Life sciences products](#)
[Volumetric Instruments](#)
[Density](#)
[Clinical Lab.](#)
[General Laboratory](#)

## Dispensette® S, Analog-adjustable Bottle-top dispenser

[Cat. No.: 4600120](#)

### Product description

The new Dispensette® S bottle-top dispenser combines innovative ideas with proven technology and makes dispensing safer and convenient.

### Innovative product highlights at a glance:

- New discharge tube, with or without recirculation valve
- New valve system - no additional sealing rings required. This greatly facilitates cleaning and preparations for autoclaving.
- Simple priming by optimized flow channels
- Less dispensing force - especially with large volume instruments
- Safe volume setting with internal scalloped track (analog-adjustable instruments)
- Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
- New instrument size 1 ml - digital and analog-adjustable models

### Proven technology:

- Autoclavable at 121 °C
- Easy to calibrate and adjust in order to comply with ISO 9001 and GLP guidelines
- Easy to dismantle for cleaning
- Replaceable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
- The 360° rotatable valve block allows the bottle label to face the user
- Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
- DE-M marking

**Dispensette® S (red color-code):** Ideal for dispensing aggressive reagents, including concentrated bases and acids such as H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (except e.g., HCl, HNO<sub>3</sub> und HF), saline solutions, as well as many organic solvents.

**Model Analog-adjustable:** Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.

### Items supplied

Dispensette® S bottle-top dispenser, DE-M marking, with performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve and recirculation tube (optional), mounting tool and adapters of polypropylene.

### Minimum order quantity / quantity interval

1 piece

### Specification

Capacity ml	subdivision ml	A (%) ± 5 %	A (µl) ± 5 µl	CV (%) ± 5 %	CV (µl) ± 5 µl	Recirculation valve
0,2 - 2	0,05	0,5	10	0,1	2	without

### Short description / Minimum order quantity, quantity interval:

Dispenser Dispensette® S, Analog-adj., DE-M, 0,2-2ml, without recirculation valve  
1 piece


**Product finder**
[Search for Cat. No/Text](#)
[Step-by-Step search](#)
**Language selection**
[Options](#)
[Print](#)
[Create PDF](#)
[My note list](#)

\* Recommended sales price without VAT (PL 2016)

Price per From Unit price\*

1 pieces/s

» Product accessories

» Spare parts for product

» Add Cat. No.: 4600120 to my note list

« back

София

Лабимекс ООД, гр. София 1404, жк. Гоче Делчев бл.261, офис Ч, тел. 02/4224160, 96215101, факс: 02/9621501, ЕИК № 131007129, ИП по УДС № BG131007129

/пълно пътноование на участници, телефон и факс: ЕИК № и ИП по УДС №

**СПЕЦИАЛИЯ**

хак Оферта за участие в обществена торъжка "чрез събиране на оферти с общи с предмет, приналежности и консумативи за химични лаборатории"


Обособена позиция №4- ФИЛТРИ И ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ

№ на обособената позиция	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение, съгласно ТС на Възложителя	Наменование, Технически показатели, опаковка и приложение на предлаганата стока	Един. Марка	Кол-во	Срок на доставка/дни	Друга информация, ако Участникът сърфа за необходимица престани
1	Филтър черна лента, №388, ф150мм, Ø опаковка 100 филтъра	Филтър черна лента, №388, ф150мм, Ø опаковка 100 филтъра	брой	3	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0011400009 Камалоз Fioroni Filters
2	Филтър, тип стеклен блокен с високо задържане, д=75мм, среден размер на порите	Филтър, тип стеклен блокен с високо задържане, д=75мм, среден размер на порите	брой	1	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0263400004 Камалоз Fioroni Filters
3	Филтър синя лента, №391, ф150, Ø опаковка 100 филтъра	Филтър синя лента, №391, ф150, Ø опаковка 100 филтъра	брой	20	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0015400009 Камалоз Fioroni Filters
4	Хартия филтърна 50x50, покритие; 1 пакет= 12,5кг	Хартия филтърна 50x50, покритие; 1 пакет= 12,5кг	кг	175	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0600000019 Камалоз Fioroni Filters
5	Филтър синя лента; ф90мм бептепелен; 100 филтъра в 1 опаковка	Филтър синя лента; ф90мм бептепелен; 100 филтъра в 1 опаковка	брой	3	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0015400005 Камалоз Fioroni Filters
6	Филтър бяла лента, цвятован, №189, ф150мм, Ø опаковка 100 броя филтъра	Филтър бяла лента, цвятован, №189, ф150мм, Ø опаковка 100 броя филтъра	брой	8	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0012400009 Камалоз Fioroni Filters
7	Филтър мембрани, големина на порите Ø 4,5мм, диаметър на коленна на порите ф0,45мм, диаметър на филтър настаннат ф24мм; бяла лента, за количествен анализ 1бр. Опаковка=10бр.	Филтър мембрани, големина на порите Ø 4,5мм, диаметър на коленна на порите ф0,45мм, диаметър на филтър настаннат ф24мм; бяла лента, за количествен анализ 1бр. Опаковка=10бр.	брой	10	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0424400023 Камалоз Fioroni Filters
8	Филтър, бяла лента, тип Filtrac; ф50мм	Филтър, бяла лента, за количествен анализ; тип Filtrac; ф50мм, опаковка 100 бр.	брой	5	45 дни	Ингатлан, Германия 1441-050 Камалоз Fioroni Filters
10	Хартия филтърна - блок за лабораторни маси, ролка 460мм, от една страна с размер- 380x205мм	Хартия филтърна почистителна, ролка с размер- 380x205мм	брой	1	45 дни	Fioroni Filters, Франция 0604R00021 Камалоз Fioroni Filters
11	Хартия лабораторна почистителна, ролка с размер- 380x205мм	Хартия лабораторна почистителна, ролка с размер- 380x205мм	брой	160	45 дни	WWR International, Австралия 115-2208 Нова Зеландия

## ПОДИСИ ПЕЧАТ:

Димитър Христов (име и фамилия)  
27.05.2016г. (дата)

Удължен (дължност на управител или представител на участника)  
Лабимекс ООД (наименование на участника)

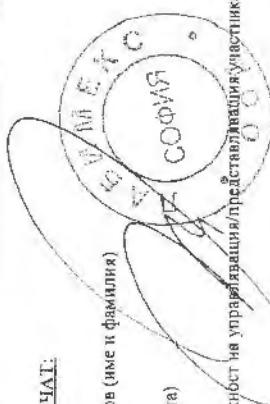

ОБРАЗЕЦ по т.III.1. към Образеца на оферта  
Лаборатория ООД, гр. София 1404, кв. Гене Делчев, бл. 261, офис Ч,тел. 02/ 422 41 60,  
02/ 962 15 01, ЕИК 131007129, ИН по ЗДС 131007129

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДС/

### ЦЕНОВАТА БЛЮЗА

#### за обособена позиция №2- ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ- ДРУГИ

Към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории”


Обособена позиция №	ИД	Наименование на обособената позиция, съгласно панелованиято и посочено в Техническата спецификация на Възложителя	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДСС
1	2		3	4	5
1	109352	Фуния за бързо филтриране, с диаметър 70-80мм, опредена отвътре	брой	5	10,61
2	109354	Банка стъклена, градуирана, с обем 5000мл, с пластмасова капачка на винт за отвар 45мм.	брой	2	58,86
3	20205	Блюдо Петри, съклено. ф120мм	брой	10	1,70
4	20213	Блюдо Петри, съклено. ф150мм	брой	10	2,50

5	20373	<i>Колба Ерленмайер 1000мл; с широко гърло; градуирана</i>	брой	5	5,23
6	20380	<i>Колба Ерленмайер 500мл; с широко гърло; градуирана</i>	брой	5	2,88
7	20383	<i>Колба юдно число 100мл; с пластмасова запушалка</i>	брой	35	6,66
8	20410	<i>Кристализатор с цилиндрична форма, ф95мм, V=300мл, плоско дъно</i>	брой	3	9,67
9	20412	<i>Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140°C, цилиндрична форма, ф190мм, V=2000мл, плоско дъно</i>	брой	3	22,17
10	20444	<i>Блюдо Петри, стъклено, ф100мм</i>	брой	10	1,30
11	20446	<i>Блюдо Петри, стъклено, ф80мм</i>	брой	25	0,99
12	20517	<i>Стъкло увеличително (лупа) х8</i>	брой	2	4,88
13	20518	<i>Стъкло часовниково ф60мл</i>	брой	10	0,68
14	20611	<i>Колба смукателна, V=1000мл</i>	брой	5	26,55
15	45038	<i>Кристализатор цилиндрична форма; плоско дъно; ф230; 3500мл</i>	брой	3	26,93
16	91310	<i>Фуния увънчена за колонка със смола; опакована х 20бр.; обем 25ml</i>	брой	1	220,00
<i>Обща предлагана цена в лв. без ДДС:</i>					1069,79

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Димитър Христов (име и фамилия)

27.05.2016г. (дата)

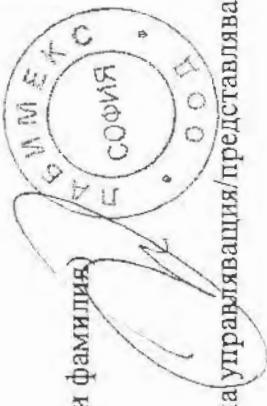

Управител (дължност на управляващия/представляващ участник)

Лабимекс ООД (наименование на участника)

Лабимекс ООД, гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч, тел. 02/ 422 41 60,  
02/ 962 15 01, ЕИК 131007129, ИН по ЗДДС 131007129

*Лъжливо написване на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/*

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

#### За обособена позиция №3- Лабораторни принадлежности

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

Обособена позиция №	ИД	Наименование на обособената позиция, согласно наименоването и посочено в Техническата спецификация на Възложителя	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3		4	5
1	108746	Дозатор към шинела, устойчив на органични разтворители, с варивац обем от 5 до 50ml	брой	5	180,00
2	117263	Комплект за пробоотбiranе UniSampler "EX" с една допълнителна стъклена буталка, 1000ml	брой	2	520,00
3	119906	Статив за центрофужна епруветка от 50ml., 20 отвора, материал ABS	брой	2	15,00
4	119907	Статив за центрофужна епруветка от 100ml., 20 отвора, материал ABS	брой	2	15,00

5	121228	Щипка лабораторна за колби, стоманена с с полиамидно покритие, дулжина 230мм, размер на отвора от 16 до 60мм	брой	2	31,50
6	13919	Индикатор за pH универсален (хартия индикаторна) pH=0-14, на лентички, 10бр. Лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/pH	брой	33	8,70
7	19736	Дозатор към шинета за киселини и основи Ø- 5ml	брой	5	180,00
8	19737	Дозатор към шинета, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с варирящ обем 1-10мл	брой	10	180,00
9	20097	Шиптула метална, от единия край- лъжица, от другия- пласка; обща дължина 180мл	брой	40	11,80
10	20152	Статив вертикален, за изсушаване на лабораторна стъклария, свободно столич	брой	1	55,64
11	20300	Щипка магнитна за магнитчета, 250/8мм	брой	2	34,74
12	20988	Маркуч силиконов, лабораторен, ф10x14мм	брой	50	4,35
13	21059	Лабораторен, каучуков, ф8-12мм (d-D)	брой	50	1,50
14	45040	Шпатула двойна, пластмасова, 150/18/20мм	брой	5	1,50
15	45093	Накрайник за автоматична пипета, тип Eppendorf, син цвят, 1мл	брой	2000	0,01
16	47512	Конница за реактиви за бхл.	брой	6	15,00

17	71849	Пипета за еднократна употреба (полиетилен), 3мл, градуирана, нестерилна, опаковка 1брой съдържа 500 пипети	брой	10	16,00
18	83255	Лепенка рН индикаторна; диапазон рН= от 0 до 2,5; 100 ленти в опаковка	брой	30	18,00
19	90823	Лепенки; за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95x95 mm- комплект по 500бр.	км	1	96,44
20	90824	Лепенки; за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150x150 mm- комплект по 250бр.	км	1	135,15
21	91365	Пипети тип пастърю за еднократна употреба /полиетилен/, градуирани до 5мл, нестерилни, 1бр.= 1 пипета	брой	1200	0,04
22	91366	Пипета за еднократна употреба, тип PE-LD, 2ml	брой	200	0,21
23	91367	Пипета за еднократна употреба; тип PE-LD, 1ml	брой	300	0,05
24	93187	Дозатор към шинищетата, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с вариращ обем 0,2-2мл	брой	10	450,00
25	93188	Дозатор към шинищета, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна, с вариращ обем 0,5-5мл	брой	12	180,00
26	93189	Дозатор към шинищета, устойчив на киселини и основи, комплект, с вариращ обем 1-10мл	брой	2	180,00
27	95123	Маркуч силikonов, ф8х14мм, висока еластичност	м	30	6,32

6

*Обща предлагана цена в лв, без ДДС:*

*14303,41*

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Димитър Христов (име и фамилия)  
OOУ  
27.05.2016г. (дата)

Управлятел (должност на управляващия/представляващия участника)

Лабимеке ООД (наименование на участника)

Лабимекс ООД, гр. София 1404, кв. Гоче Делчев, бл. 261, офис Ч, тел. 02/ 422 41 60,  
02/ 962 15 01, ЕИК 131007129, ИН по ЗДДС 131007129

/пълно нарименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

#### за обособена позиция №4- ФИЛТРИ И ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

Обособена позиция №	ИД	Наименование на обособената позиция, съгласно наименоването и посочено в Техническата спецификация на Възложителя	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2		3	4	5
1	105960	Филтър черна лента, №388, ф150мт, в опаковка 100 филтъра	брой	3	22,74
2	106030	Филтър, тип стъклени влакна с високо задържане, d=47мм, среден размер на порите 0,7мм за определение на обичи очиствания в дизелово гориво, 1бр. Опаковката съдържа 100бр. Филтри	брой	1	41,41
3	13949	Филтър синя лента, №391, ф150, в опаковка 100 филтъра	брой	20	22,71

4	13969	Хартия филтърна 50x50, пакетирана; 1 пакет=12,5кг	кг	175	7,20
5	13990	Филтър синя лента; ф90мм без метален; 100 филтъра в 1 опаковка	брой	3	9,44
6	13991	Филтър бяла лента, цепулозен, №389, ф150мм, 1брой опаковка стъдъръса 100 броя филтри	брой	8	22,74
7	20131	Филтър мембраниен, големина на порите ф0,45мм, диаметър на филтъра 47мм; опаковка от 100бр	брой	10	36,66
8	22630	Филтър на гъннат ф24см; 1бр. Опаковка=100бр. Филтри	брой	7	134,57
9	22672	Филтър; бяла лента; тип Filtrac; ф50мм	брой	5	30,00
10	46280	Хартия филтърна - бяла за лабораторни маси, ролка 460мм, от една страна с попечителено покритие, не пропускащо течности	брой	1	92,99
11	95115	Хартия лабораторна почиствача, ролка с размер- 380x205мм	брой	160	21,40
<i>Обща предлагана цена в лв. без ДДС:</i>					7009,65

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Димитър Христов (име и фамилия)  
27.05.2016г. (дата)

Управител (дължност на управляващия/представляващия участника)

Лабимекс ООД (наименование на участника)

Димитър Христов  
София