

# ДОГОВОР

№...178000013

Днес, 17.07.2017 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег.№ 7239 от 19.10.2016г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Лабимекс" ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204542274, представлявано от Димитър Буйнов Христов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 и следващите /част пет, глава двадесет и шеста, раздел трети/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории**", се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории по Обособена позиция № 4 - Лабораторни съдове-пластмасови, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **3 005,47** /три хиляди и пет лева и четиридесет и седем стотинки/ лева, без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010.

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. еднократно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

## 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена еднократно, в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на двустранното му подписване.

## 4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация /на български език/ на експедираната стока трябва да съдържа :

4.5.1. Приемно-предавателен протокол;

4.5.2. Декларация/Сертификат за произход;

4.5.3. Партиден сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти;

4.6. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, отговаряща на стандартните и техническите изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението ѝ по време на транспортиране.

4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.9 При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.13. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

## 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоката, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок по т. 5.4.

5.5. Рекламации от установяването на отклоненията се оформя в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на констатираните отклонения и/или несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които рекламацията се счита за уредена.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.
- 6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора
- 6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- 6.3.1. Приложение №1 – Общи условия на договора;
- 6.3.2. Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- 6.3.3. Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- 6.3.4. Приложение №4 – Предлагана цена.
- 6.4. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Аксиния Ходкевич – Р-л сектор ФХК, ЕП2, тел.: 0973/ 73035.
- 6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Мария Ангелова – Търговски директор, тел.: 0885 761970.
- 6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Лабимекс” ООД, гр. София  
1404 София  
кв. Гоце Делчев, бл.261, офис Ч  
тел/факс: 02/4224160, 9621501  
E-mail: [labimex@mail.bg](mailto:labimex@mail.bg)  
ЕИК: 204542274  
ИН по ЗДДС: 204542274

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
ДИМИТЪР ХРИСТОВ

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

Директор „Производство“.....  
30.06.2017 г. /Я. Янков/

Директор И и Ф:.....  
29.06.2017 г. /Г. Кирков/

Р-л У-ние “Търговско”.....  
28.06.2017 г. /М. Латева/

Р-л У-ние “Правно”.....  
29.06.2017 г. /К. Русалийска/

Р-л сектор ФХК, ЕП2:.....  
16.06.2017 г. /А. Ходкевич/

Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”.....  
28.06.2017 г. /И. Петрова/

Н-к отдел ОП:.....  
15.06.2017 г. /С. Брешкова/

Изготвил:.....  
15.06.2017 г. /И. Борисова/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ.....	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	9
16.	НЕУСТОЙКИ .....	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	12

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

#### 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно

законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за



техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна

безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя

сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

#### 14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

#### 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при сключване на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
“Лабимекс” ЕООД, гр. София  
1404 София  
кв. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч  
тел/факс: 02/4224160, 9621501  
E-mail: [labimex@mail.bg](mailto:labimex@mail.bg)  
ЕИК: 204542274  
ИН по ЗДДС: 204542274

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**УПРАВИТЕЛ**  
ДИМИТЪР ХРИСТОВ



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР**  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ





**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА ДОСТАВКА НА**

**ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА), ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛАБОРАТОРНИ МЕРНИ СЪДОВЕ - СТЪКЛЕНИ**

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед.
1.	20143	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 10 ml $\pm$ 0,025 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	10	бр.
2.	20144	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 20 ml $\pm$ 0,04 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	6	бр.
3.	20169	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 100 ml $\pm$ 0,10 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	40	бр.
4.	20170	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 250 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.
5.	20171	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.
6.	65222	Колба мерителна, тъмно стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	2	бр.
7.	45024	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 50 ml $\pm$ 0,06 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	40	бр.
8.	45027	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ml $\pm$ 0,25 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**



9.	45029	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 2000 ml $\pm$ 0,6 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	6	бр.
10.	45030	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 200 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	20	бр.
11.	20221	Пипета шприц, тип Резила, обем 5 ml $\pm$ 0,03 ml при 20°C, градуирана през 0,05 ml, клас на точност AS, сертифицирана по DIN	30	бр.
12.	20243	Пипета с обем 0,5 ml $\pm$ 0,005 при 20°C, тип Мор, градуирана през 0,01 ml, клас на точност AS, сертифицирана по DIN	10	бр.
13.	109358	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 10 ml $\pm$ 0,02 ml, сертифицирана по DIN	10	бр.
14.	20253	Пипета Фол, обем 10 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,02 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	8	бр.
15.	20255	Пипета Фол, обем 20 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.
16.	20256	Пипета Фол, обем 25 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.
17.	20257	Пипета Фол, обем 50 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,05 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.
18.	20258	Пипета Фол, обем 100 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,08 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	15	бр.
19.	20383	Колба йодно число, мерителен обем до 100 ml, градуирана, с пластмасова запушалка	20	бр.
20.	109340	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 50 $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	10	бр.
21.	109341	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 100 $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	10	бр.
22.	109342	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 250 $\pm$ 1 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 2 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	5	бр.
23.	109344	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 500 $\pm$ 2,5 ml клас на точност А, синя или кафява градуировка през 5 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	7	бр.
24.	109346	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 1000 $\pm$ 5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 10 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	5	бр.
25.	20591	Чаша Бехер 25 ml, ниска форма, градуирана	50	бр.
26.	20597	Чаша Бехер 50 ml, ниска форма, градуирана	50	бр.
27.	20585	Чаша Бехер 100 ml, висока форма, градуирана	20	бр.

8

28.	20586	Чаша Бехер 100 ml, ниска форма, градуирана	20	бр
29.	20587	Чаша Бехер 150 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
30.	20588	Чаша Бехер 150 ml, ниска форма, градуирана	30	бр.
31.	20594	Чаша Бехер 400 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
32.	20595	Чаша Бехер 400 ml, ниска форма, градуирана	80	бр.
33.	20598	Чаша Бехер 600 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
34.	20599	Чаша Бехер 600 ml, ниска форма, градуирана	40	бр.
35.	20584	Чаша Бехер 1000 ml, ниска форма, градуирана	30	бр.
36.	20589	Чаша Бехер 250 ml, висока форма, градуирана	10	бр.
37.	20590	Чаша Бехер 250 ml, ниска форма, градуирана	10	бр.
38.	45062	Чаша Бехер 2000 ml, висока форма, градуирана	4	бр.
39.	20592	Чаша Бехер 3000 ml, ниска форма, градуирана	20	бр.

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед.
1.	20517	Състкво увеличително (луца) x 8,	1	бр.
2.	20097	Шпатула за реактиви, метална, от единия край тип лъжичка, а от другия плоска, обща дължина 180 mm	5	бр.
3	45040	Шпатула, двойна пластмасова, размери 150/18/20 mm	10	бр.
4.	123739	Тапа, силиконова, твърда, с размери: външен D=38 mm, вътрешен D=31mm, H=35 mm	1	бр.
5.	123740	Тапа, гумаена, твърда, с размери :външен D=38 mm, вътрешен D=31mm, H=35 mm	1	бр.
6.	20615	Щипка за тигли, с размери , L=23÷25 cm	2	бр.
7.	20277	Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 300/240/70 mm	6	бр.
8.	123742	Тава лабораторна, химически устойчива на киселини, термоустойчива до 120 <sup>0</sup> C с приблизителни размери 430/290/20 mm	5	бр.
9.	20278	Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 353/252/21 mm	6	бр.
10.	119906	Статив за центрофужни епруветки от 50 ml, материал ABS, 20 отвора	10	бр.

11.	62481	Стагив за сепарирани (делителни) фунии за 4 бр. делителни фунии от 500 ml, и 1000 ml, материал PP, диаметър на основата ф 400 mm; височина 80 mm;	1	бр.
12.	20152	Стагив, вертикален, за изсушаване на лабораторна стъклария, свободно стоящ	1	бр.
13.	20223	Стагив, вертикален, полипропиленов, за пипети с две основи	1	бр.
14.	45004	Стагив, вертикален, пластмасов, за 6 броя автоматични пипети (тип Eppendorf)	5	бр.
15.	20988	Маркуч лабораторен, силиконов, ф 10-14 mm (d-D)	50	м
16.	45093	Накрайник за автоматична пипета с фиксиран обем, тип Eppendorf, обем 1000 µl	1000	бр.
17.	93646	Кутия с капак за крайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 50 до 1000 µl	3	бр.
18.	93647	Кутия с капак за крайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 0,5 до 5 ml	3	бр.
19.	47512	Кошница за реактиви, материал полипропилен, гладка повърхност, удобна за дезактивация; за реактивни бутилки 6x11; диаметър на гнездата 100 mm	6	бр.
20.	47513	Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 4x11	3	бр.
21.	91365	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 5 ml, градуирана през 0,5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 1 пипета)	1000	бр.
22.	71849	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 3 ml, градуирана през 0,5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 500 пипети)	5	бр. опаковки
23.	91366	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 2 ml, градуирана	2300	бр.
24.	91367	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 1 ml, градуирана	2300	бр.
25.	20619	Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 10-100 µl, с партиден сертификат с точност	1	бр.
26.	19737	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 37 % солна и 65 % азотна киселина, с вариращ обем 1-10 ml, с партиден сертификат с указана точност	5	бр.
27.	108746	Дозатор към лабораторни шишета, комплект, химически устойчив на органични разтворители, с вариращ обем 5-50 ml, през деление 0,1-0,2 ml, точност $\leq \pm 0,5 \%$ , с партиден сертификат с указана точност	2	бр.
28.	93187	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем от 0,2 -2ml, с партиден сертификат с указана точност	5	бр.
29.	93188	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем от 0,5 -5ml, с партиден сертификат с указана точност	5	бр.
30.	20131	Филтър мембранен, големина на порите ф 0,45 µm, диаметър на филтъра 47 mm, опаковка от 100 броя	10	бр. опаковка

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед
1.	20122	Гутатор тъмно стъкло V= 50 ml	9	бр.
2.	20444	Блодо Петри, стъкло, с диаметър 100 mm	10	бр.
3.	109352	Фуния за бързо филтруване, диаметър 70÷80 mm, оребрена отвътре	20	бр.
4.	45061	Фуния делителна, стъклена, V= 500 ml, крушовидна форма, разграфена	5	бр.
5.	82173	Фуния делителна, стъклена, V= 1000 ml, крушовидна форма, разграфена	5	бр.
6.	12678	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 250 ml, диаметър на отвора 35 mm	100	бр.
7.	12677	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 1000 ml	550	бр.
8.	56341	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 500 ml	540	бр.

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ПЛАСТМАСОВИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед
1.	122762	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 10 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
2.	122763	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 25 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
3.	45137	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 50 ml ± 0,06 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
4.	122764	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 250 ml ± 0,15 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
5.	20268	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 100 ml ± 0,10 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
6.	20269	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
7.	20270	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
8.	122659	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 5 ml ± 0,05 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока	9	бр.

		форма с основа		
9.	109348	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), обем 500 ml $\pm$ 2,5 ml, клас на точност А, синя градуировка през 5 ml, висока форма с основа	15	бр.
10.	122660	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 10 ml $\pm$ 0,1 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	11	бр.
11.	45097	Пръскалка, пластмасова РР, вместимост 250 ml	8	бр.
12.	20261	Чаша Бехер РР 150 ml, полипропиленова, градуирана	20	бр.
13.	20070	Чаша Бехер РР 25 ml, полипропиленова, градуирана	20	бр.

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ**

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М. ед
1.	105960	Филтър черна лента, целулозен, № 388, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	5	бр. опаковка
2.	13949	Филтър синя лента, целулозен, № 391, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	33	бр. опаковка
3.	13990	Филтър синя лента, безпелелен, № 391, диаметър 90 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	20	бр. опаковка
4.	22672	Филтър бяла лента, целулозен, № 389, диаметър 50 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	7	бр. опаковка
5.	106030	Филтър, тип стъклен влакна с голямо задържане, диаметър 47 mm, среден размер на порите 0,7 $\mu$ m, за определяне на общи онечиствания в дизелово гориво, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	1	бр. опаковка
6.	13969	Хартия филтърна, пакетирана, с размери 50 cm x 50 cm, за лабораторни цели, 1 пакет = 12,5 kg	13	бр. пакет
7.	13919	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0 $\div$ 14) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 броя лентички в пластмасова кутия със скала –цвет/ рН	8	бр. опаковка
8.	83255	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0 $\div$ 2,5) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 броя лентички в пластмасова кутия със скала –цвет/ рН	20	бр. опаковка
9.	99460	Резач за лента парафинова, тип Parafilm М, ширина 100 mm	2	бр.
10.	90823	Лепенки за залепване на чували, след проботобиране с размери 95 x 95 mm, един комплект по 500 бр.	1	бр. комплект

11.	90824	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150 x150 mm, един комплект по 250 бр.	1	бр. комплект
12.	95115	Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 x 205 mm	294	бр.
13.	46280	Хартия филтърна-бяла,за лабораторни маси, ролка 460 mm, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропусकाщо течности	10	бр.
14.	46281	Хартия филтърна-бяла,за лабораторни маси, ролка 600 mm, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	10	бр.

**Задължителни изисквания:**

1. В предоставените от фирмите-участнички оферти към всеки лабораторен продукт, от дадена обособена група, да **бъде посочен каталожен номер**, названието на каталога и името на фирмата-производител.
2. Да се осигурят оригиналните каталози с подробна техническа информация.
3. За Обособена позиция №1. **Лабораторни мерни съдове-стъклени**, които са с клас на точност А и АS при доставката им в АЕЦ да бъдат придружени с партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебсайта на производителя. На всеки мерен стъклен съд с клас на точност А, АS да има обозначен мерителния обем ± толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема както и класа на точност на съда.
4. При входящия контрол в АЕЦ "Козлодуй"-ЕАД, да се представи сертификата за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти.

Лабилекс ООД., гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч, тел. 02/422 41 60, факс 02/962 15 01, ЕИК 131007129 ИН по ЗДДС BG131007129

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории"

## Обособена позиция №4. Лабораторни съдове- пластмасови (наименование)

№ на обособената позиция	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение, съгласно ТС на Възложителя	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Срок на доставка/ дни	Друга информация, ако Учасникът смята за необходимо да представи
1	2	3	4	5	6	7
1	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 10 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 10 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67704, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
2	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 25 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 25 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67104, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
3	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 50 ml ± 0,06 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 50 ml ± 0,06 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67204, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
4	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 250 ml ± 0,1 5 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 250 ml ± 0,1 5 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67404, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
5	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 100 ml ± 0,10 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 100 ml ± 0,10 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67304, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
6	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67504, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
7	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.	90 дни	Кат. Номер -67604, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог
8	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 5 ml ± 0,05 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 10 ml ± 0,2 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	9	бр.	90 дни	Кат. Номер -35108, производител Brand, Германия, издава от електронен каталог
9	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), обем 500 ml ± 2.5 ml, клас на точност А, синя градуировка през 5 ml, висока форма с основа	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), обем 500 ml ± 2.5 ml, клас на точност А, синя градуировка през 5 ml, висока форма с основа	15	бр.	90 дни	Кат. Номер -35154, производител Brand, Германия, издава от електронен каталог
10	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 10 ml ± 0,1 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 10 ml ± 0,1 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	11	бр.	90 дни	Кат. Номер -34614, производител VITLAB, Германия, издава от електронен каталог

11	Пръскалка, пластмасова РР, вместимост 250 ml	Пръскалка, пластмасова РР, вместимост 250 ml	8	бр.	90 дни	Кат. Номер 44310000, производител Delalab, Германия, извадка от електронен каталог
12	Чаша Бехер РР 150 ml, полипропиленова, градуирана	Чаша Бехер РР 150 ml, полипропиленова, градуирана	20	бр.	90 дни	Кат. Номер 4090061, производител VITLAB, Германия, извадка от електронен каталог
13	Чаша Бехер РР 25 ml, полипропиленова, градуирана	Чаша Бехер РР 25 ml, полипропиленова, градуирана	20	бр.	90 дни	Кат. Номер 409023, производител Delalab, Германия, извадка от каталог

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Димитър Христов (име и фамилия)

07.04.2017г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представящия участник)

Лаблмекс ООД (наименование на участника)



*(Handwritten mark)*



# Volumetric flasks, PMP, Class A with NS stoppers, PP

Volume measurement, Volumetric flasks

## Product labeling:

DIN ISO-compliant Class A volumetric instruments

Products individually packaged in PE bags, labelled with the article number, description and EAN code

Products that can be autoclaved at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. Note restrictions!

Enquiry No.: 67704

Crystal clear.

with ring mark individually calibrated to 'In'.

Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042.

With printed lot number and batch certificate.

Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit.

To preserve markings. cleaning at no higher than 60 °C is recommended.


Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.

## Types / Sizes:

Volume (ml)	Tolerance ( $\pm$ ml)	Height (mm)	Neck (NS)	PU	Cat. No.
10	0.04	90	10/19	6	67704
25	0.04	115	10/19	6	67104
50	0.06	150	12/21	6	67204
100	0.10	180	14/23	6	67304
250	0.15	235	19/26	5	67404
500	0.25	270	19/26	4	67504
1000	0.40	310	24/29	3	67604


ВАРНО С  
ОРИГИНАЛНА



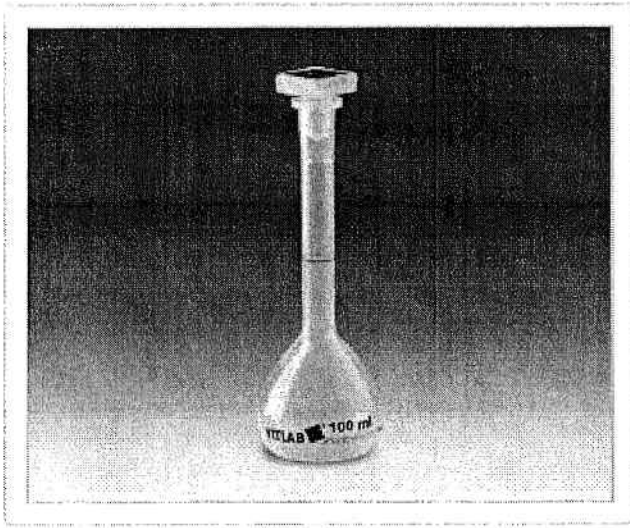

**BROCHURE:** <http://www.vitlab.com/en/downloads-en/competence-in-measuring-volume/>

© 2017 VITLAB GmbH [www.vitlab.com](http://www.vitlab.com). All rights reserved.

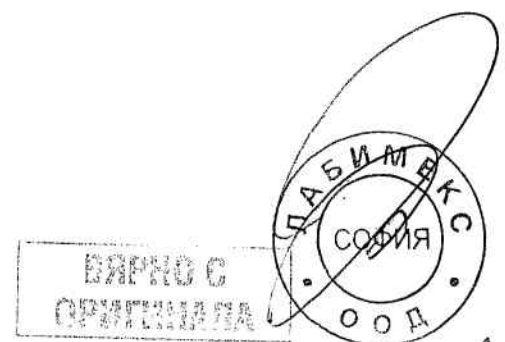



[Home](#) [Contact](#) [Privacy](#) [Terms & Conditions](#) [Imprint](#)

Product groups

Liquid Handling

Life science products

Volumetric Instruments

Bulb- / graduated pipettes

Volumetric Flasks

Graduated- / mixing-cylinders

Graduated / Mixing Cylinders,  
BLAUBRAND®

Graduated / Mixing Cylinders,  
SILBERBRAND

Graduated Cylinders, Plastics

Dispensers, fill measure

Burettes

Automatic Burettes

Density

Clinical Lab.

General Laboratory

**Graduated cylinders, class A, PMP  
Class A, DE-M marking, incl. one batch certificate. Tall form with  
blue printed scale.**

Cat. No.: 35108

Product description

PMP, transparent. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. A particularly high-quality printing ink is used in the BRAND graduated cylinders. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.

Minimum order quantity / quantity interval

2 pieces

Specification

Capacity	subdivision	Error limits A	height
ml	ml	± ml	mm
10	0,2	0,10	145

Short description / Minimum order quantity, quantity interval


Grad.cylinder,tall, class A, 10:0,2ml, PMP,blue graduation  
2 pieces

\* Recommended sales price without VAT (PL 2017)

Price per	From	Unit price*
1 piece/s	2	

► Add Cat. No.: 35108 to my note list

⏪ back

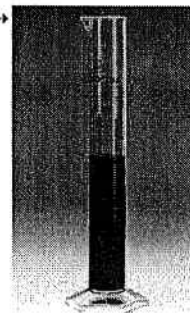

Product finder



Search for Cat.No./text

► Step-by-Step search

Language selection





Options

► Print

► Create PDF

► My note list

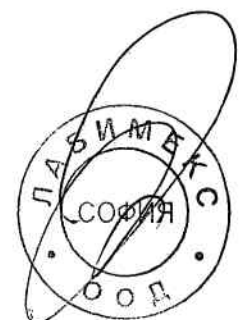



[Home](#) [Contact](#) [Privacy](#) [Terms & Conditions](#) [Imprint](#)

Product groups

Liquid Handling

Life science products

Volumetric Instruments

Bulb- / graduated pipettes

Volumetric Flasks

Graduated- / mixing-cylinders

Graduated / Mixing Cylinders,  
BLAUBRAND®

Graduated / Mixing Cylinders,  
SILBERBRAND

Graduated Cylinders, Plastics

Dispensers, tilt measure

Burettes

Automatic Burettes

Density

Clinical Lab.

General Laboratory

Graduated cylinders, class A, PMP

Class A, DE-M marking, Incl. one batch certificate. Tall form with blue printed scale.

Cat. No.: 35154

Product description

PMP, transparent. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. A particularly high-quality printing ink is used in the BRAND graduated cylinders. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.

Minimum order quantity / quantity interval

2 pieces

Specification

Capacity	subdivision	Error limits A	height
ml	ml	± ml	mm
500	5	2,5	360

Short description / Minimum order quantity, quantity interval

Grad.cylinder,tall, cl. A, 500:5ml, PMP,blue graduation


2 pieces

\* Recommended sales price without VAT (PL 2017)

▶ Add Cat. No.: 35154 to my note list

add

◀ back

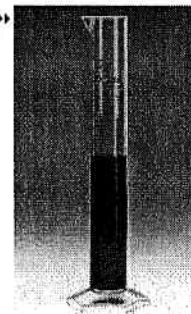

Product finder



Search for Cat.No./text

▶ Step-by-Step search

Language selection




Options:

▶ Print

▶ Create PDF

▶ My note list

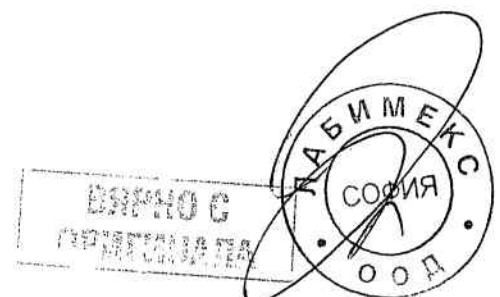

# Graduated cylinders, PMP, Class A, tall form, red printed scale

Graduated cylinders, Volume measurement

## Product labeling:

DIN ISO-compliant Class A volumetric instruments

DE-M marking for conformity certified products according to the German Measurement and Calibration Regulation

Products individually packaged in PE bags, labelled with the article number, description and EAN code

Enquiry No.: 64614

Crystal clear. DE-M marked.

with red printed scale and ring marks at the primary scale points, calibrated "In".

The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions.

The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706.

With printed batch number and the year of production.


Hexagonal base with bottom studs provides high stability.

To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60 °C. Thus, conditionally autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. For autoclaving we recommend the design with raised graduations (Cat.-No. 64604 – 65304).


Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.

## Types / Sizes:

Volume (ml)	Tolerance ( $\pm$ ml)	Graduation (ml)	Height (mm)	$\emptyset$ (mm)	PU	Cat. No.
10	0.10	0.20	145	15	2	64614
25	0.25	0.50	170	22	2	64714
50	0.50	1.00	200	27	2	64814

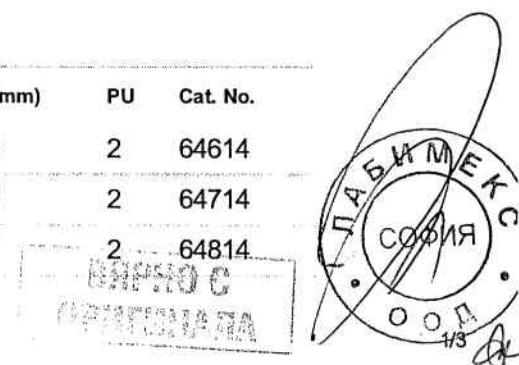

Volume (ml)	Tolerance ( $\pm$ ml)	Graduation (ml)	Height (mm)	$\emptyset$ (mm)	PU	Cat. No.
100	0.50	1.00	250	33	2	64914
250	1.00	2.00	315	44	2	65014
500	2.50	5.00	360	58	1	65114
1000	5.00	10.00	440	69	1	65214
2000	10.00	20.00	535	97	1	65414

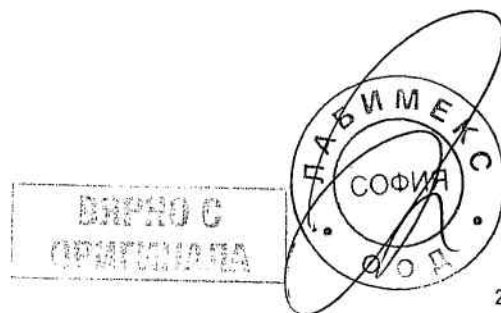

## Wash bottles

Made a combination of high and low density polyethylene.  
Translucent bottle, with HDPE cap (blue), delivery tube and seal cap (natural).  
Bottle caps are ribbed for a better handling.  
High resistance to all liquids, acids and bases.  
Include a large neck for safe and easy filling.


code	capac. ml	neck mm	base mm	height mm	case quantity	case weight	case volume
44330000	250	30	65	155	90	5.30	0.078
44300000	500	30	75	185	60	4.85	0.080
44310000	1,000	30	90	222	45	5.02	0.110



## Wide mouth wash bottles

Translucent low density polyethylene bottles, with screw cap and delivery tube available in 3 different colours (blue, yellow and red) for easy identification. Feature a one piece cap and delivery tube assembly, thus eliminating air or liquid absorption through the cap.  
Include a wide neck for safe and easy filling.  
Ribbed caps for a better handling while opening and closing.  
Moulded-in graduations.  
250 ml model is graduated in 25 ml increments, 500 ml model, in 100 ml increments.  
DIN: GL45.


code	capac. ml	cap colour	int. neck Ø mm	base Ø mm	height mm	case quantity	case weight	case volume
191637.04	250	blue	38	60	140	10	0.64	0.018
191637.06	250	yellow	38	60	140	10	0.64	0.018
191637.10	250	red	38	60	140	10	0.64	0.018
191638.04	500	blue	38	75	165	10	0.84	0.019
191638.06	500	yellow	38	75	165	10	0.84	0.019
191638.10	500	red	38	75	165	10	0.84	0.019

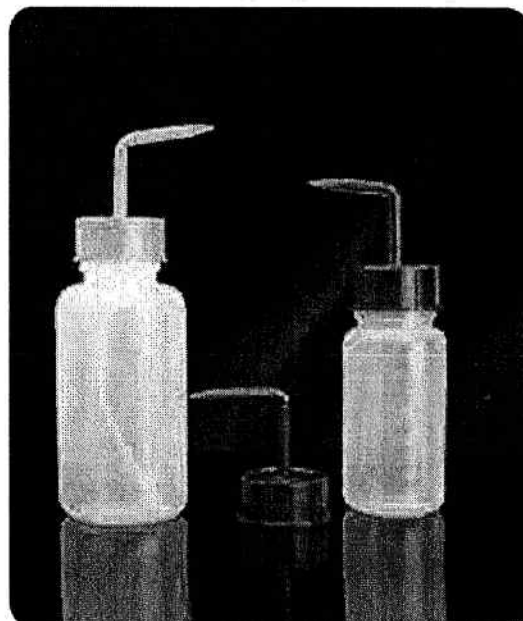

## Integral wash bottles

Made of translucent polyethylene.  
Feature a one piece cap and delivery tube assembly, which eliminates air or liquid absorption through the cap and ensures a positive leaktight seal.  
To increase liquid flow, cut the tip of the delivery tube; close the tip by means of the cap attached to the delivery tube.  
Caps are ribbed for a better handling while opening and closing.  
Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure. Bottles include a fill in line.

code	capac. ml	height mm	neck d/n std.	case quantity	case weight	case volume
191633	250	143	GL32	10	0.68	0.008
191634	500	181	GL32	10	0.84	0.015

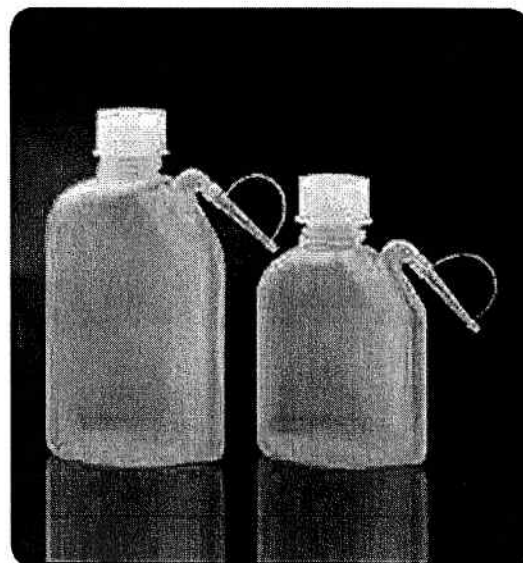

HYGIENE, SAFETY AND GENERAL LABWARE

deltalab

БАРНОС  
ОБРАТНАТА



# Griffin beakers, PP, raised blue scale

Food-safe products, Griffin beakers, Volume measurement

## Product labeling:

Food-safe products according to EC Directive No. 10/2011

Enquiry No.: 605081

Highly transparent.

With easily readable raised, embossed blue scale.

According to ISO 7056.

To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60 °C.

Conditionally autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. For autoclaving we recommend the design with raised graduations (Cat. No. 606941 – 617941).

## Types / Sizes:

Volume (ml)	Divisions (ml)	Height (mm)	Ø (mm)	PU	Cat. No.
10*	2	36	30	12	605081**
25	5	50	38	12	606081**
50	10	60	47	12	607081**
100	10	70	55	12	608081
150*	20	80	66	12	609081
250	25	95	77	6	610081
400*	50	111,5	87	6	611081
500	50	117,5	94	6	618081
600*	50	126,5	100	6	612081
1000	100	147	120	6	614081
2000	200	187	149	6	615081
3000	250	212	170	4	616081






Volume (ml)	Divisions (ml)	Height (mm)	Ø (mm)	PU	Cat. No.
5000	500	247	203	4	617081

\* Variant in addition to ISO 7056

\*\* Blue printed scale, not raised

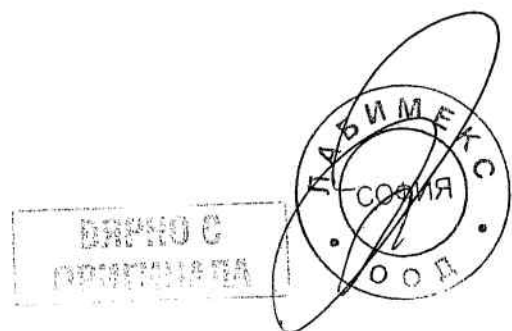

1-13

### Graduated beakers

Made of TPX. **Autoclavable to 170 °C.**  
ISO 6706 and BS 5404 standards.

code	capacity (ml)	height (mm)	Ø (mm)	height (mm)	max. capacity (ml)	base weight (g)	base volume (ml)
191720	25	1	35	49	20	0.17	0.001
191721	50	2	42	60	20	0.28	0.003
191722	100	5	52	72	12	0.70	0.004
191723	250	10	71	96	16	1.45	0.011
191724	500	10	90	120	12	2.10	0.015
191725	1,000	20	110	149	4	1.20	0.010
191726	2,000	50	135	184	4	2.00	0.018
191727	3,000	500	160	200	2	1.80	0.014


Minimum order quantity: 1.



### Graduated beakers

Made of transparent polypropylene. **Autoclavable a 121 °C.**  
ISO 6706 and BS 5404 standards. Blue graduation.


code	capacity (ml)	height (mm)	Ø (mm)	height (mm)	max. capacity (ml)	base weight (g)	base volume (ml)
191822	50	2	42	60	20	0.31	0.004
191823	100	5	52	72	12	0.35	0.004
191824	250	10	71	96	16	0.75	0.010
191825	500	10	90	120	12	1.05	0.015
191826	1,000	20	110	149	4	0.49	0.010
191827	2,000	50	135	184	4	0.60	0.018
191828	3,000	500	160	200	2	0.90	0.014
191829	5,000	500	191	230	2	1.40	0.022

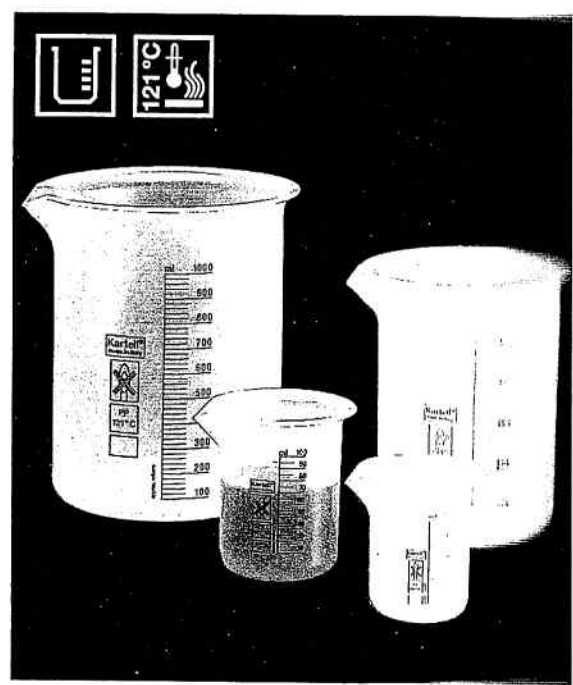

### Graduated beakers

Material: transparent polypropylene. **Autoclavable up to 121 °C.**  
In compliance with ISO 6706 and BS 5404 standards.

code	capacity (ml)	height (mm)	Ø (mm)	height (mm)	max. capacity (ml)	base weight (g)	base volume (ml)
409025	25		35	50	20	0.22	0.002
409050	50		42	60	20	0.29	0.004
409100	100		53	72	12	0.33	0.004
409250	250		71	96	16	0.72	0.011
409500	500		90	120	12	0.88	0.015
491000	1,000		110	149	4	0.49	0.009
492000	2,000		135	184	4	0.86	0.017
493000	3,000		160	200	2	0.88	0.022
495000	5,000		191	230	2	2.00	0.022

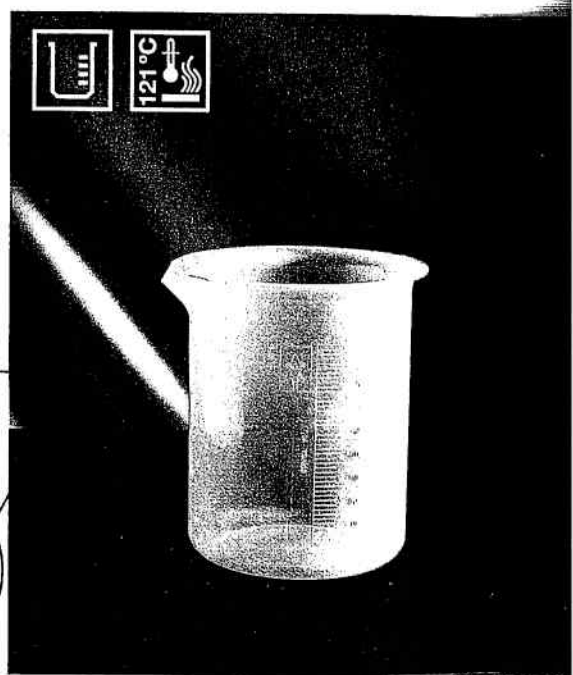

ВАРНО С  
ОРИГИНАЛ  
ПАС М НОВА  
СОФИЯ  
С О Д

13

## ОБРАЗЕЦ по т.Ш.1. към Образеца на оферта

Лабимекс ООД, гр. София, ж.к. Голе Делчев, бл. 261, офис Ч, тел. 02/ 422 41 60, факс 02/ 962 15 01, ЕИК 131007129, ИН по ЗДДС BG131007129 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

#### за обособена позиция №4 Лабораторни съдове- пластмасови

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

#### “ Доставка на лабораторни съдове /стъклария и пластмаса/, принадлежности и консумативи за химични лаборатории”

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	М.ед.	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	122762	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 10 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	15,29	152,90
2.	122763	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 25 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	15,87	158,70
3.	45137	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 50 ml ± 0,06 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	20,75	207,50
4.	122764	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 250 ml ± 0.1 5 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	29,79	297,90

5.	20268	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 100 ml ± 0,10 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	23,43	234,30	
6.	20269	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	30,97	309,70	
7.	20270	Колба	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	бр.	10	36,14	361,40	
8.	122659	Цилиндър	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 5 ml ± 0,05 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	бр.	9	18,85	169,65	
9.	109348	Цилиндър	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), обем 500 ml ± 2.5 ml, клас на точност А, синя градуировка през 5 ml, висока форма с основа	бр.	15	51,59	773,85	
10.	122660	Цилиндър	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 10 ml ± 0,1 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	бр.	11	21,07	231,77	
11.	45097	Пръскалка	Пръскалка, пластмасова РР, вместимост 250 ml	бр.	8	2,00	16,00	
12.	20261	Чаша Бехер	Чаша Бехер РР 150 ml, полипропиленова, градуирана	бр.	20	2,59	51,80	
13.	20070	Чаша Бехер	Чаша Бехер РР 25 ml, полипропиленова, градуирана	бр.	20	2,00	40,00	
							Обща предлагана цена в лв. без ДДС	3005,47

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Димитър Христов (име и фамилия)

07.04.2017 г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

Лабимекс ООД (наименование на участника)

