



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на полиетиленови пликосе и фолия”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че прави уточнения по техническата спецификация на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за „Доставка на полиетиленови пликосе и фолия”, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / **Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 36165.**

Въпрос:

За обособена позиция 1 – пликосе полиетиленови

Какво се разбира под изискването „със затварящ кант”?

Отговор:

Полиетиленовите пликосе да се затварят с цип, за да има възможност за многократна употреба.

Въпрос:

За обособена поз.2 – фолия

Посоченото тегло 1,7 кг. бруто или нето тегло е?

Отговор:

Теглото е нето.

Въпрос:

За обособена позиция 3 – плик за индивидуален дозиметър

Има ли възможност за чертеж с размери?


Отговор:

Да, прилагаме чертеж /Приложение 1/.

Всички останали условия в обществената поръчка остават непроменени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 / 7 6163, или електронен адрес ctyotova@npp.bg.

Плик полиетиленов за индивидуален дозиметър ИД 45516

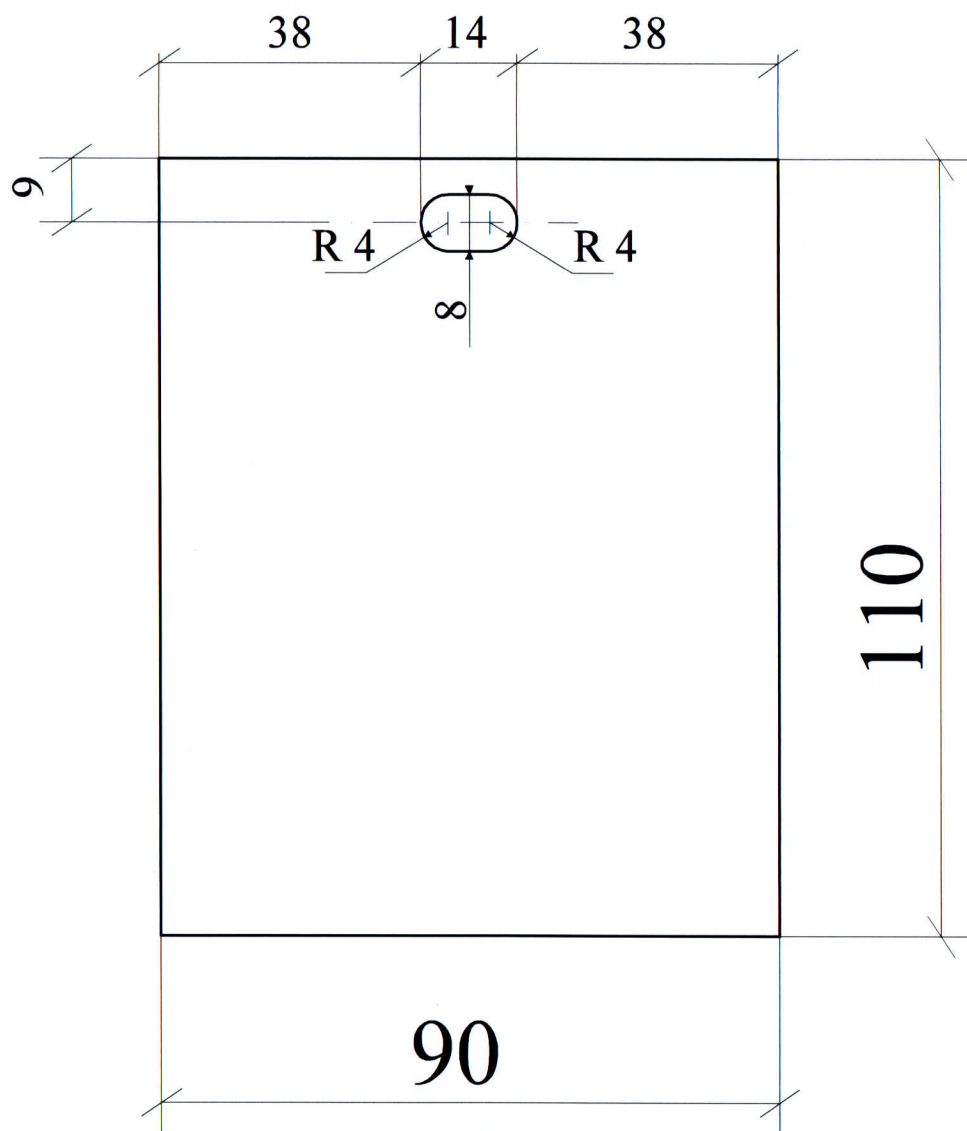

Легенда:

1. Дебелина на полиетилена от 0.11 до 0.13мм
2. Посочените размери на плика са в милиметри